

A comparison of thresholds in auditory steady – state response with pure tone audiometry in subjects with normal hearing and those with mild and moderate sensorineural hearing loss

Sadegh Jafarzadeh¹, Bahram Jalaie², Dr. Mohammad Kamali³

¹-Ear, Nose, Throat, Head & Neck Surgery and Related Sciences Research Center, Mashhad, Iran

²-Audiology Department, Faculty of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Iran.

³-Rehabilitation Management Department, Faculty of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Iran.

Abstract

Background and Aim: Among all auditory assessment tools, auditory steady state response (ASSR) is a modern test. Modulation frequency for this test is usually 80 Hz. The purpose of this study, was to examined adult subjects with 40 Hz and 80 Hz ASSR and compare the results.

Materials and Methods: Thirty adult (60 ears) were evaluated by ASSR and PTA test, Results were divided into three groups: normal hearing, mild and moderate sensorineural hearing loss.

Results: In all groups, forty hertz ASSR thresholds were relatively closer to behavioral threshold than those of 80 Hz ASSR($p<0.05$). Besides, the more severe hearing loss, the lower the difference between those two thresholds. Correlation coefficients were also higher in 40 Hz ASSR($p<0.05$).

Conclusion: Frequency modulation thresholds with 40 Hz are more likely to be closer to the behavioral thresholds. Moreover, it has better results than the thresholds with 80 Hz.

Keywords: auditory steady state response, pure tone audiometry, threshold, modulation frequency, sensorineural hearing loss

مقاله پژوهشی

مقایسه آستانه‌های پاسخ‌های پایدار شنوایی و تن خالص در افراد با شنوایی هنجار و افراد دچار کم شنوایی حسی- عصبی ملایم و متوسط

صادق جعفرزاده^۱، بهرام جلایی^۲، دکتر محمد کمالی^۳

^۱- مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی، جراحی سر و گردن دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

^۲- گروه آموزشی شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ایران

^۳- گروه مدیریت توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: پاسخ‌های پایدار شنوایی آزمون نوینی در مجموعه آزمون‌های شنوایی است. معمولاً برای انجام این آزمون، از فرکانس مدولاسیون ۸۰ هرتز استفاده می‌شود. در این پژوهش، آزمون پاسخ‌های پایدار شنوایی در فرکانس مدولاسیون ۴۰ و ۸۰ هرتز، در افراد بزرگسال مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل از آستانه‌یابی در آنها مقایسه شد.

روش بررسی: آزمون پاسخ‌های پایدار شنوایی و آستانه‌های تن خالص روی ۳۰ فرد بزرگسال و در مجموع ۶۰ گوش انجام شد و نتاج آن‌ها در سه گروه شنوایی هنجار، کم‌شنوایی حسی - عصبی ملایم و متوسط طبقه‌بندی شد.

یافته‌ها: در هر سه گروه، آستانه‌های پاسخ‌های پایدار شنوایی ۴۰ هرتز به آستانه رفتاری نزدیک‌تر بود($p < 0.05$) و با افزایش میزان کم‌شنوایی، تفاوت بین آستانه رفتاری و پاسخ‌های پایدار شنوایی کمتر می‌شود. میزان همبستگی نیز در پاسخ‌های پایدار شنوایی ۴۰ هرتز بیشتر بود($p < 0.05$).

نتیجه‌گیری: در افراد بزرگسال در حالت بیداری، آستانه‌های فرکانس مدولاسیون ۴۰ هرتز به آستانه رفتاری نزدیک‌تر است و آستانه‌گیری در این فرکانس مدولاسیون نتایج بهتری نسبت به ۸۰ هرتز را در پی دارد.

واژگان کلیدی: پاسخ‌های پایدار شنوایی، ادیومتری تن خالص، آستانه، فرکانس مدولاسیون، کم‌شنوایی حسی - عصبی

() وصول مقاله: ۱۱/۱۸/۸۶، پذیرش: ۲۳/۶/۸۷)

مقدمه

محدوده‌ی کمتر از ۲۰ هرتز، ۲۰ تا ۵۰ هرتز و بالاتر از ۵۰ هرتز تقسیم می‌کنند. منشأ پاسخ‌ها با فرکانس مدولاسیون کمتر از ۲۰ هرتز کورتکس شنوایی است. این پاسخ‌ها معادل با امواج دیررس شنوایی (Late Latency Response: LLR) هستند و وضعیت هوشیاری و داروها تأثیر شگرفی در ثبت آنها دارد. پاسخ‌های ۵۰ هرتز عمدتاً به تalamوس و کورتکس شنوایی تعلق دارند. در حقیقت این پاسخ‌ها مشابه با امواج میان‌رس شنوایی (Middle

Auditory Steady state Response: ASSR) روشی نوین در بین آزمون‌های الکتروفیزیولوژیک است. در این روش تن‌های مدوله شده AM و FM به جای محرک‌های معمول کلیک و تن برس استفاده قرار می‌گیرند و بر حسب فرکانس مدولاسیون، بخش‌های مختلفی از سیستم شنوایی را تحریک می‌کنند.

پاسخ‌های ASSR را بر حسب فرکانس مدولاسیون به سه

روش بررسی

این مطالعه بصورت توصیفی - تحلیلی مقایسه‌ای انجام شده است و در آن مراجعه کنندگان به کلینیک شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال ۱۳۸۵-۸۶ مورد ارزیابی قرار گرفتند.

در این پژوهش از روش نمونه‌گیری غیر احتمالی از نوع مستمر استفاده شد و آزمون‌ها روی ۳۰ فرد بزرگسال (۶۰ گوش) انجام شد. این افراد بین ۱۰ تا ۵۰ سال داشتند و در سه گروه دارای شنوایی هنجار، کم‌شنوایی‌های حسی - عصبی ملايم و متواتر طبقه‌بندی شدند. از آنجایی که جنس بر آستانه‌یابی با پاسخ‌های پایدار شنوایی تأثیری ندارد این ویژگی مدنظر قرار نگرفته است.

معیارهای ورود به این پژوهش شامل موارد زیر بود:

- الف - میانگین آستانه‌های تن خالص در محدوده افراد هنجار یا کم شنوایی ملايم و متواتر باشد.
- ب - تاریخچه و علائمی از کم شنوایی انتقالی وجود نداشته باشد.
- پ - اختلال عصبی وجود نداشته باشد (این موضوع با گرفتن آزمون Speech In Noise مشخص شد)

ت - سابقهای از عمل گوش، تومور آکوستیک، بیماری MS، ضربه به سر، سکته مغزی، صرع، مشکلات حسی - حرکتی و اختلالات عصبی وجود نداشته باشد.

در این پژوهش اطلاعات بر اساس پاسخ‌های آزمون رفتاری PTA و آزمون الکتروفیزیولوژیک ASSR بدست می‌آمد. آزمون ادیومتری تن خالص با دستگاه AC30 و آزمون ASSR با دستگاه CHARTER، ICS ساخت کارخانه Madsen کشور دانمارک انجام شد.

ابتدا آزمون‌های پایه شنوایی‌شناسی انجام می‌شد. این آزمون‌ها شامل: تاریخچه‌گیری، اتوسکپی (با استفاده از اتوسکپ Riester ساخت آلمان)، تمپانومتری و رفلکس آکوستیک (با دستگاه AZ7 کارخانه Madsen ساخت کشور دانمارک) SDS، SRT (با ادیومتر AC30 کارخانه Madsen ساخت کشور دانمارک) بود. سپس آزمون Speech In Noise (با ادیومتر

Latency Response: MLR) هستند و وضعیت هوشیاری و داروها بر جنبه‌هایی از آزمون تأثیرگذار است. پاسخ‌های فرکانس‌های مدولاسیون بالاتر از ۵۰ هرتز عمدتاً از ساقه مغز ثبت می‌گردد و مولدهای عصبی آن به امواج ABR شبیه است. در سال ۲۰۰۲ Sininger تأثیری بر این آستانه‌ها ندارند(۱).

John و همکاران در سال ۲۰۰۴ نشان دادند که میان آستانه‌های PTA و ASSR در فرکانس‌های میانی و بالا تطابق خوبی وجود دارد و آستانه‌ی مناسب را می‌توان در فرکانس مدولاسیون‌های مختلف بدست آورد. اما در فرکانس‌های پایین، اغلب تفاوت این دو آستانه بیشتر است(۲). از طرف دیگر این میزان، یک مقدار عددی ثابت نیست و با افزایش میزان کم شنوایی بتدریج کمتر می‌شود. تفاوت آستانه‌های PTA و ASSR در افراد هنجار و افراد دچار کم شنوایی حسی - عصبی ملايم و متواتر، بیشتر از کم شنوایی‌های شدید و عمیق است. این مقدار در افراد هنجار به ۲۵ dB با انحراف معیار ۱۰ دسی‌بل می‌رسد که این موضوع تخمین دقیق آستانه از روی پاسخ ASSR را مشکل می‌کند(۱ و ۳).

روش‌های مختلفی جهت بهبود آستانه‌یابی در فرکانس‌های پایین وجود دارد. یکی از این روش‌ها، تغییر مدولاسیون محرك است. در تحقیقات مختلف نشان داده شده است که با تغییر فرکانس مدولاسیون محرك، می‌توان آستانه‌گیری بهتری را در فرکانس‌های پایین داشت و تخمین آستانه PTA را با دقت و صحت بیشتری انجام داد. اما در مورد میزان تغییر آستانه نسبت به تغییر فرکانس مدولاسیون، اعداد متفاوتی ذکر شده است و هماهنگی کلی در این بین وجود ندارد(۴-۶).

به طور کلی هدف از انجام این پژوهش، تعیین و مقایسه میانگین تفاوت آستانه‌های PTA و ASSR با فرکانس مدولاسیون ۴۰ و ۸۰ هرتز در افراد هنجار، افراد مبتلا به کم شنوایی حسی - عصبی ملايم و متواتر بوده است. در این مقاله همچنین این تفاوت در فرکانس‌های مختلف با هم مقایسه شده است.

جدول ۱ - تفاوت بین آستانه‌های ASSR ۴۰ هرتز و PTA در افراد هنجار و کم‌شنوایا

میانگین (انحراف معیار) ASSR ۴۰ هرتز					میزان شنوایی
۴۰۰۰	۲۰۰۰	۱۰۰۰	۵۰۰		
(۶/۰۴) ۱۹/۵۰	(۵/۹۳) ۲۲/۰۰	(۵/۱۰) ۲۴/۵۰	(۶/۱۲) ۲۴/۲۵		شنوایی هنجار
(۷/۸۲) ۵/۷۵	(۶/۲۵) ۸/۷۵	(۴/۴۷) ۱۱/۰۰	(۳/۰۶) ۱۳/۲۵		کم‌شنوایی ملایم
(۵/۷۲) ۴/۷۵	(۴/۴۱) ۸/۰۰	(۷/۱۸) ۹/۰۰	(۵/۴۹) ۹/۷۵		کم‌شنوایی متوسط

ثبت به روش Multiple ASSR انجام می‌شد. روش آستانه‌گیری نیز مشابه با روش آستانه‌گیری برای PTA بود. سطح شروع آستانه‌گیری ۳۰ دسی‌بل SL (نسبت به PTA) بود، سپس شدت در گام‌های ده دسی‌بلی کاهش می‌یافت. این روند تا جایی ادامه پیدا می‌کرد که دیگر پاسخی قابل شناسایی نباشد. آنگاه شدت در گام‌های ۵ دسی‌بلی افزایش پیدا می‌کرد تا جایی که پاسخ قابل رویتی بdest آید.

روش‌های آماری مورد استفاده شامل شاخص‌های میانگین‌گیری، میانه، مد و انحراف معیار و برای آنالیز تحلیلی، همبستگی بود.

در هنگام انجام آزمایش نیز، برای رعایت نکات اخلاقی آزمون‌ها برای بیماران توضیح داده می‌شد و از آنها رضایت‌نامه کتبی گرفته می‌شد.

یافته‌ها

به‌طور کلی آستانه‌های PTA در بین محدوده‌ی صفر تا ۸۰ دسی‌بل قرار داشت و نمونه‌ها بر اساس میانگین آستانه فرکانس‌های ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ هرتز در سه گروه افراد دارای شنوایی هنجار، افراد مبتلا به کم شنوایی حسی - عصبی ملایم و متوسط قرار گرفتند. در گروه کم‌شنوایی ملایم، میانگین کم شنوایی با افزایش فرکانس، افزایش می‌یافت. در حقیقت، در این گروه اغلب نمونه‌ها دارای ادیوگرام شیبدار بودند. در حالی که در گروه کم‌شنوایی متوسط، شکل ادیوگرام مسطح‌تر بوده است و به‌طور کلی در فرکانس‌های پایین، ASSR با ۴۰ هرتز نسبت به

AC30 و به صورت زنده) جهت انتخاب نمونه‌ها از بین مراجعه-کنندگان انجام می‌شد. اگر در این آزمون، میزان امتیاز به دست آمده تفاوتی در حد بیش از ۴۰ درصد با آزمون SDS داشت، بیمار از مطالعه حذف می‌شد. و با کسب اختلاف کمتر از ۳۹ درصد احتمال وجود مشکلات عصبی، متصور نبود(۷). پس از انجام این ارزیابی‌ها، آزمون ASSR در دو فرکانس مدولاسیون ارزیابی می‌شد. در اوایل جلسه به دلیل همکاری بهتر و عدم خستگی بیمار پاسخ ۴۰ هرتز ثبت می‌شد، سپس پاسخ ۸۰ هرتز ثبت می‌گردید. فرکانس‌های مورد آزمایش ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ هرتز بود که در شدت‌های پایین (کمتر از ۵۰ دسی‌بل) بصورت دو گوشی و چند فرکانسی و در شدت‌های بالاتر از این میزان بصورت دو گوشی و تک فرکانسی بررسی می‌گردید. در تحریک دو گوشی، دو گوش به صورت همزمان تحریک می‌شود. اما به دلیل اینکه فرکانس‌های مورد آزمایش در مقادیر متفاوتی مدوله شده‌اند، پاسخ‌های عصبی دو گوش با هم آمیخته نمی‌شود و بصورت کاملاً مجزا بررسی می‌گردد. این موضوع برای یک فرکانس یکسان که به صورت همزمان به دو گوش فرستاده می‌شود، نیز صادق است. دیگر پارامترهای آزمون شامل موارد زیر بودند:

نحوه الکترودگذاری: پشت گردن (Reference) c7، ورتكس (Active)، پیشانی Ground.

فیلتر: ۱۰-۱۰۰ Hz ۵۰ Hz notched

امپدانس: کمتر از ۵ کیلو اهم

تفاوت فرکانس مدولاسیون در بین CF‌های مجاور: ۴ Hz

محرك: AM 100% + FM 25%

جدول ۲ - تفاوت بین آستانه‌های ASSR ۸۰ هرتز و PTA در افراد هنجار و کم‌شنوا

میانگین (انحراف معیار) ASSR ۸۰ هرتز					میزان شنوا
۴۰۰۰	۲۰۰۰	۱۰۰۰	۵۰۰		شناوهای هنجار
(۶/۲۶) ۲۰/۵۰	(۶/۱۲) ۲۱/۷۵	(۵/۴۹) ۲۷/۲۵	(۶/۷۸) ۲۷/۵۰		شناوهای هنجار
(۸/۵۶) ۵/۵۰	(۷/۸۵) ۱۰/۲۵	(۵/۹۳) ۱۳/۰۰	(۵/۹۵) ۲۰/۲۵		کم‌شنواهای ملایم
(۵/۴۷) ۷/۰۰	(۴/۱۶) ۱۱/۰۰	(۵/۳۸) ۱۰/۰۰	(۵/۴۰) ۱۳/۵۰		کم‌شنواهای متوسط

در ASSR با ۴۰ هرتز نیز با افزایش فرکانس، میزان همبستگی افزایش می‌یافتد. در فرکانس‌های پایین همبستگی بسیار خوبی بین این آزمون و PTA وجود داشت. تمامی نتایج مربوط به این آزمون معنی‌دار بوده و ضرایب همبستگی نشان دهنده ارتباط قوی بین این دو آزمون هستند و در همه موارد نسبت F بزرگ‌تر و میزان p برای ۵۰۰ هرتز ۰/۰۰۰۶، برای ۱۰۰۰ هرتز ۰/۰۰۰۴، برای ۲۰۰۰ هرتز ۱/۰۰۰۱ و برای ۴۰۰۰ هرتز ۱/۰۰۰۰ بود.

بحث

الف - مقایسه آستانه‌یابی فرکانس مدولاسیون ۴۰ هرتز با ۸۰ هرتز

آزمون ASSR روشی برای تخمین آستانه در فرکانس‌های مختلف است. با این آزمون می‌توان شکل و میزان کم‌شنواهی را مشخص کرد. اما مشکل عمدۀ در این میان، آستانه‌یابی فرکانس‌های پایین است. در این فرکانس‌ها تفاوت بین آستانه رفتاری و ASSR، بیشتر از سایر فرکانس‌ها بود. این موضوع بویژه در افراد دارای شنواهی هنجار چشمگیر بود.


تفاوت آستانه ASSR و PTA در افراد هنجار بیشتر از افراد مبتلا به کم شنواهی است و با افزایش افت شنواهی، تفاوت بین این دو آزمون کاهش می‌یابد. اما با مقایسه کم‌شنواهی ملایم با متوسط می‌توان دریافت که تنها در آزمون ASSR با ۸۰ هرتز در فرکانس ۵۰۰ هرتز، تفاوت بین این دو آزمون بصورت معنی‌داری کاهش می‌یابد. در دیگر فرکانس‌ها نیز این کاهش تفاوت

ASSR با ۸۰ هرتز به آستانه رفتاری نزدیک‌تر است. به عنوان مثال، تفاوت بین ASSR در فرکانس مدولاسیون ۴۰ و ۸۰ هرتز در فرکانس ۵۰۰ هرتز در افراد مبتلا به کم شنواهی ملایم به هفت دسی‌بل می‌رسید. در حالی که در فرکانس‌های بالاتر، این برتری از بین می‌رود (جدول ۲).

تفاوت بین آستانه‌های ASSR و PTA در بین گروه‌های اول - دوم و اول - سوم معنی‌دار بود و آستانه‌های ASSR گروه سوم نسبت به دیگر گروه‌ها به آستانه رفتاری نزدیک‌تر بود. اما در بین گروه دوم و سوم در فرکانس‌های ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ هرتز تفاوت بین آستانه‌های ASSR (در هر دو MF) و PTA معنی‌دار نبود.

در ASSR در هر دو فرکانس مدولاسیون، ضریب همبستگی نشان دهنده ارتباط قوی بین این آزمون و PTA بود. این میزان در فرکانس‌های ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ هرتز در ASSR با ۸۰ هرتز به ترتیب ۰/۹۴۲، ۰/۹۲۸، ۰/۹۱۰ و ۰/۹۱۸ بود (نمودار ۱) و در ASSR با ۴۰ هرتز به ترتیب ۰/۹۳۶، ۰/۹۱۸ و ۰/۹۵۱ بود (نمودار ۲).

به طور کلی در ASSR با ۸۰ هرتز با افزایش فرکانس، ضریب همبستگی افزایش می‌یافتد اما در فرکانس‌های پایین نیز، بین ASSR و PTA همبستگی مطلوبی وجود داشت. تمامی نتایج همبستگی فوق معنی‌دار بود و نسبت F بزرگ‌تر از یک می‌باشد. میزان p برای ۵۰۰ هرتز ۰/۰۰۰۵، برای ۱۰۰۰ هرتز ۰/۰۰۰۲، برای ۲۰۰۰ هرتز ۰/۰۰۰۱ و برای ۴۰۰۰ هرتز ۰/۰۰۰۰ بود.

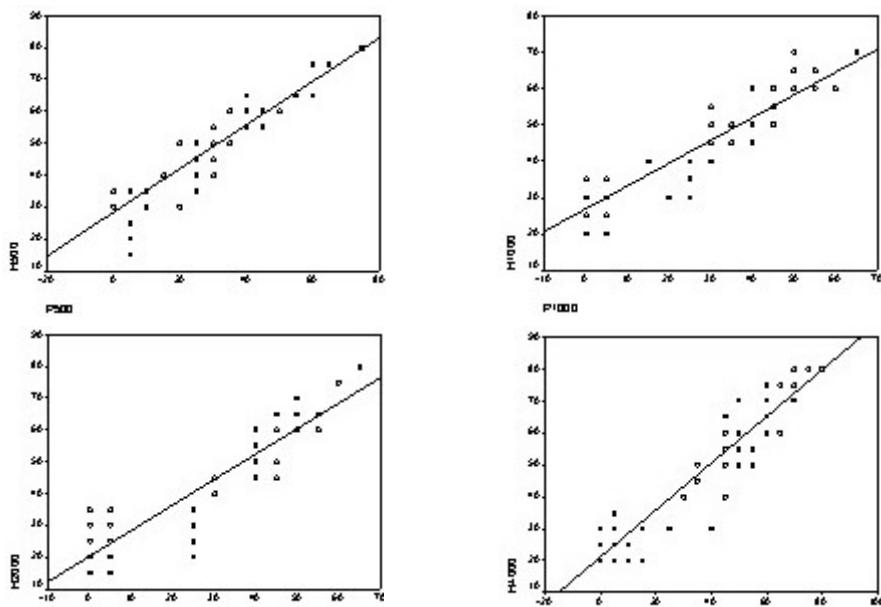

نمودار ۱- منحنی پراکندگی ASSR با ۸۰ هرتز در فرکانس‌های ۵۰۰ تا ۴۰۰۰ هرتز


چشمگیر بود. اما در افراد دچار کم شنوایی متوسط، تفاوت بین این دو آزمون در فرکانس‌های بالا نمود بیشتری پیدا می‌کند. در این افراد آزمون ASSR با ۴۰ هرتز دارای عملکرد بهتری بود. این یافته برخلاف تحقیق Pictone و همکاران در سال ۲۰۰۷ است(۸). این محققان نشان دادند که در MF های پایین (۴۰ HZ) عموماً امتیازاتی در مورد بزرگسالان در CF های پایین (۱۰۰۰ و پایین‌تر) وجود دارد و MF های بالاتر (بالاتر از 60HZ) معمولاً برای CF های بالاتر مناسب هستند. اما در تحقیق ذکر شده نحوه الکترودگذاری با این تحقیق متفاوت بوده است و شاید این عامل باعث اختلاف این دو شده است. در حقیقت با تغییر آرایش الکترودی و ثبت پتانسیل‌ها از نقاط مختلف می‌توان آستانه‌های متفاوتی را بدست آورد.

شكل ادیوگرام در ASSR با ۴۰ هرتز به آستانه رفتاری نزدیک‌تر است. این موضوع ممکن است در افراد مبتلا به کم‌شنوایی غیرعضوی از اهمیت زیادی برخوردار باشد. بیشتر این افراد دارای مقداری کم شنوایی حقیقی هستند و سعی می‌کنند آن را بیشتر جلوه دهند. به علت اینکه اغلب کم‌شنوایی‌ها در فرکانس‌های

وجود دارد که البته از لحاظ آماری معنی‌داری نیست. در آستانه‌یابی با ASSR، افت بیشتری در فرکانس‌های پایین مشاهده شد. این م屁股 به خصوص در آستانه‌یابی با فرکانس مدولاسیون ۸۰ هرتز مشاهده گردید. این نتایج مشابه با تحقیق Vander و همکاران در سال ۲۰۰۵ است(۳). به طور کلی در آزمون‌های الکتروفیزیولوژیک، آستانه فرکانس‌های پایین فاصله و اختلاف بیشتری با آستانه‌های Rftarی دارند اما شاید نتوان این موضوع را در آزمون ASSR همانند آزمون ABR با تن برسی به کاهش همزمانی عصبی نسبت داد زیرا در ASSR همزمانی عصبی تأثیر چندانی ندارد.

با استفاده از فرکانس مدولاسیون ۴۰ هرتز، تفاوت بین آستانه رفتاری و ASSR کمتر شد. این امر در افراد هنجار، باعث شناسایی آستانه پایین‌تری شد و همانگی و یکنواختی بیشتری در بین فرکانس‌های مختلف مشاهده شد.

در فرکانس‌های بالا، تفاوت چندانی در عملکرد آزمون ASSR با ۴۰ هرتز با ASSR با ۸۰ هرتز وجود نداشت. در حقیقت فرکانس مدولاسیون ۴۰ هرتز اندکی بهتر از ۸۰ هرتز بود. این یافته در افراد دارای شنوایی هنجار و کم شنوایی ملایم

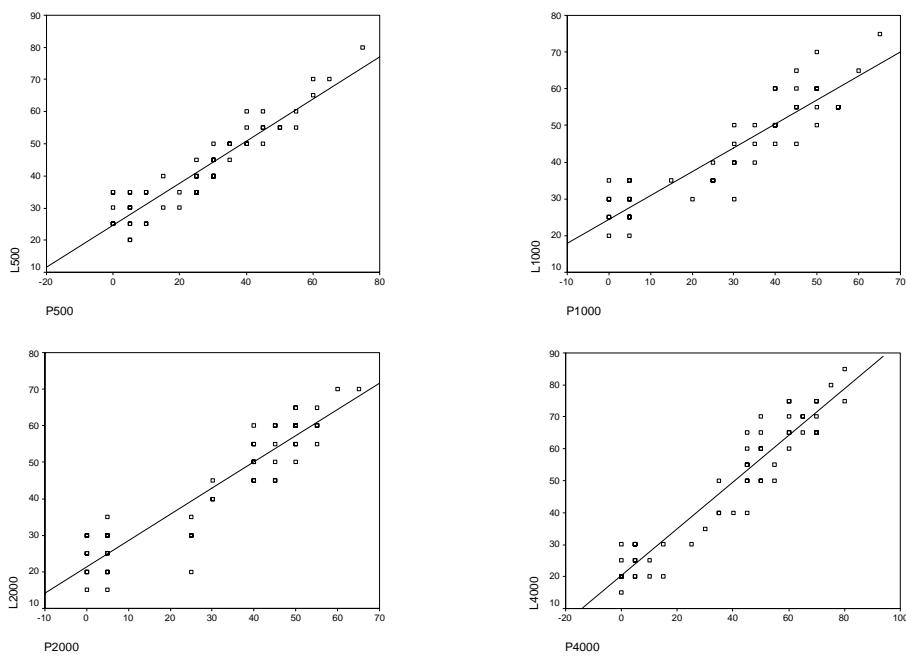

نمودار ۲ - منحنی پراکندگی ASSR با ۴۰ هرتز در فرکانس‌های ۵۰۰ تا ۴۰۰۰ هرتز

بین فرکانس مدولاسیون ۴۰ و ۸۰ هرتز می‌تواند باعث شناسایی سطح پایین‌تری از شدت به عنوان آستانه شود.

به طور کلی میزان نویز EEG در فرکانس‌های پایین بیشتر از فرکانس‌های بالاست. از این رو ممکن است کشف آستانه بهتر در فرکانس مدولاسیون پایین تعجب برانگیز باشد. در حقیقت علی‌رغم بیشتر بودن محتوای نویز، میزان دامنه پاسخ در این فرکانس‌ها بسیار بیشتر است. این موضوع باعث بوجود آمدن نسبت سیگنال به نویز بالاتری در این فرکانس‌ها می‌شود و در آستانه‌یابی با فرکانس مدولاسیون ۴۰ هرتز، تفاوت بین آستانه رفتاری و ASSR کمتر خواهد بود. اما در برخی افراد ممکن است محتوای نویز در فرکانس‌های پایین بسیار زیاد باشد. که ممکن است ثبات پاسخ را در این فرکانس‌ها تحت تأثیر قرار دهد.

در تحقیقات مختلف نیز آستانه ASSR با ۴۰ هرتز در سطوح شدتی پایین‌تری نسبت به ASSR با ۸۰ هرتز بدست آمد و زمان صرف شده برای آزمون ASSR با ۴۰ هرتز نیز در هر دو تحقیق کمتر از ASSR با ۸۰ هرتز بود(۶۴). که دلیل این امر

بالا بوجود می‌آید، رکورتمان این افراد مانع تمارض مقدار بالایی از کم‌شنوایی در این فرکانس‌ها می‌شود. در نتیجه تفاوت بین آستانه واقعی و آستانه ادعا شده بیمار در فرکانس‌های پایین بیشتر است. Aoyagi و همکاران در ۱۹۹۹ دریافتند که آزمون ASSR با فرکانس مدولاسیون ۴۰ هرتز می‌تواند بخوبی این افراد را از افراد دچار کم‌شنوایی واقعی جدا کند. اما فرکانس مدولاسیون ۸۰ هرتز چندان برای این موضوع مناسب نیست(۹). در حقیقت بیشتر افراد دچار کم‌شنوای غیرعضوی، بزرگسال هستند. در طول آزمایش تحت تأثیر داروهای خواب آور قرار ندارند و اغلب بخوبی سطح هوشیاری خود را در طول آزمایش حفظ می‌کنند و به خواب نمی‌روند. از این رو آزمون ASSR با ۴۰ هرتز می‌تواند آستانه این افراد را مشخص کند. این در حالی است که آستانه ASSR با ۸۰ هرتز فاصله بیشتری با آستانه رفتاری دارد و این آزمون بویژه در فرکانس‌های پایین و افراد هنجار عملکرد مناسبی ندارد. در کار بالینی، آزمون‌های الکتروفیزیولوژیک، در گام‌های ۱۰dB مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. از این رو اختلاف چند دسی‌بل

ملايم است. اين حالت مخصوصاً در فرکانس‌های پاين به وفور دیده می‌شود. اما با استفاده از فرکانس مدولاسيون ۴۰ هرتز به طرز مطلوبی می‌توان اين افراد را از هم جدا نمود. با اين کار تا حدود زيادي، اين محدوديت برطرف می‌شود.

به طور کلي آستانه‌های ASSR با ۴۰ هرتز به نزديکتر است. اين نزديکی حتى در موارد شنوایی هنجار مشاهده می‌شود. به جدول ۱ توجه کنيد. با افزایش آستانه از حد هنجار تا ميزان کم شنوایی ملايم، ميانگين اختلاف بين ASSR با ۴۰ هرتز و PTA به سرعت افت پيدا می‌کند. اين موضوع مخصوصاً در فرکانس‌های پاين مشخص‌تر است. در اين محدوده سرعت کاهش اختلاف بين ASSR با ۸۰ هرتز و PTA کمتر از اين ميزان است. اما با مقایسه کم شنوایی ملايم با کم شنوایی متوسط مشخص می‌شود که کاهش اختلاف بين ASSR با ۴۰ هرتز و PTA در اين محدوده کمتر از ASSR با ۴۰ هرتز و PTA است. اين موضوع در حالی دیده می‌شود که تقریباً در تمامی موارد اختلاف بين ASSR با ۴۰ هرتز و PTA کمتر از اختلاف بين ASSR با ۸۰ هرتز و PTA است. اين یافته نشان‌دهنده اين موضوع است که آزمون ASSR با ۴۰ هرتز در کم شنوایی‌های ملايم و متوسط عملکرد نسبتاً يكسانی دارد و از اين رو در شناسایي و افتراء افراد کم شنوای از هنجار، دارای عملکرد بهتری است. اما بين فرکانس مدولاسيون ۴۰ و ۸۰ هرتز در فرکانس‌های بالا اختلاف چندانی وجود ندارد.

در حقیقت بر اساس یافته‌های Ballay و همکاران در سال ۲۰۰۵ ممکن است ASSR با ۸۰ هرتز آستانه پاين‌تری را در فرکانس‌های بالا در افراد مبتلا به کم شنوایی متوسط شناسایي (۱۰).

ب- مقایسه CF‌های مختلف در آزمون ASSR

ASSR آزمونی با ويژگی فرکانسي بالا است و توانايی مطلوبی در تخمين آستانه رفتاري نوزادان، کودکان و افراد بزرگسال دارد(۱۱) و آن را می‌توان در حالت‌های مختلف خواب و بیداري و بهصورت چند فرکانسي و همزمان انجام داد(۱۲). به طور معمول در ارزیابی‌های ASSR از فرکانس مدولاسيون ۸۰ هرتز

بزرگتر بودن دامنه پتانسیل‌های برانگیخته در فرکانس‌های مدولاسيون پاين نسبت به فرکانس‌های بالا است. البته ميزان نويز EEG در اين فرکانس‌ها نيز بيشتر است اما به طور کلي ميزان سیگنال به نويز در فرکانس‌های پاين بالاتر است.

در مطالعه حاضر، تفاوت بين آستانه‌های ASSR و PTA در بين گروه‌های هنجار و کم شنوای ملايم و يا افراد هنجار و کم شنوای متوسط معنی‌دار بود. اما اين اختلاف در بين دو گروه کم شنوایی ملايم و کم شنوای متوسط تفاوت معنی‌داری نداشت. اين یافته در تمامی فرکانس‌ها در هر دو فرکانس مدولاسيون مشاهده گردید و تنها در آزمون ASSR با ۸۰ هرتز در فرکانس ۵۰۰ Hz تفاوت بين اين دو گروه معنی‌دار بود. با بررسی اين یافته می‌توان نتيجه گرفت که با افزایش آستانه شنوایی از حد هنجار تا مقدار کم شنوایی ملايم اختلاف بين آستانه‌های ASSR و PTA به طور چشمگيری کاهش می‌يابد اما از مقدار کم شنوایی ملايم تا متوسط اين تغيير محسوس نیست. در حقیقت تفاوت بين نتایج کم شنوایی‌های ملايم بيشتر به نتایج کم ASSR و PTA در کم شنوایی‌های ملايم ميزان است و شاید بتوان در کار بالينی از يك ضریب اصلاحی برای تخمين آستانه رفتاري در اين افراد استفاده کرد. البته اين موضوع در فرکانس ۵۰۰ هرتز صادر نیست و ميانگين امتياز سه گروه (هنجار، کم شنوای ملايم و کم شنوای متوسط) در آزمون ASSR با ۸۰ هرتز دارای اختلاف معنی‌دار است. از اين رو می‌توان نتيجه گرفت که با افزایش آستانه شنوایی از حد هنجار تا کم شنوایی متوسط، تفاوت بين آستانه ASSR و PTA در فرکانس ۵۰۰ هرتز به طور چشمگيری کاهش می‌يابد. اما اختلاف بين ASSR با ۴۰ هرتز و PTA در فرکانس ۵۰۰ هرتز معنی‌دار نیست. در حقیقت اين فرکانس مانند ديگر فرکانس‌ها، در بين اين دو گروه اختلاف معنی‌دار ندارد. از اين رو آزمون ASSR با ۴۰ هرتز در گروه کم شنوایی ملايم دارای عملکرد بهتری است و شباهت بيشتری از لحاظ عملکرد در بين فرکانس‌های آن وجود دارد.

يکي از بزرگترین محدوديت‌های آزمون ASSR، عدم توانايی در جداسازی افراد هنجار از افراد مبتلا به کم شنوایی

تأثیرگذار باشد. به طور کلی در اکثر پژوهش‌ها و در این تحقیق، در کم شنوازی‌های متوسط و کمتر از آن، بین ASSR و PTA همبستگی مطلوبی وجود دارد. به طور کلی ضریب همبستگی آزمون ASSR با ۴۰ هرتز بالاتر از آزمون ASSR با ۸۰ هرتز در تمامی فرکانس‌ها است که این موضوع نشان‌دهنده ارتباط قوی‌تر بین این آزمون و PTA است.

نتیجه‌گیری

آستانه ASSR در فرکانس مدولاسیون ۴۰ هرتز در افراد هنجار و کم شنواز ملایم و متوسط به آستانه رفتاری نزدیکتر است. در حالی که در این افراد تفاوت بین آستانه ASSR با ۸۰ هرتز و آستانه رفتاری در بیشترین میزان قرار دارد و این موضوع در فرکانس‌های پایین صادق است. استفاده از فرکانس مدولاسیون ۴۰ هرتز می‌تواند روش مناسبی برای جبران این موضوع باشد. از این رو در ارزیابی شنوازی افراد بزرگسال، در حالت بیداری استفاده از فرکانس مدولاسیون ۴۰ هرتز به جای ۸۰ هرتز پیشنهاد می‌گردد.

سپاسگزاری

از همکاران محترم گروه شنوازی شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که کمال همکاری را در روند انجام این پژوهش مبذول داشتند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنیم.

استفاده می‌شود. در نوزادان نیز به علت انجام آزمون در حالت خواب، امکان انجام آن در فرکانس‌های مدولاسیون پایین‌تر وجود ندارد(۱۳). لیکن در مورد کودکان و بزرگسالان ممکن است استفاده از پاسخ ۴۰ هرتز دارای مزایای زیادی باشد. در هر دو آزمون ASSR با ۴۰ و ۸۰ هرتز، آستانه فرکانس ۴۰۰۰ هرتز به آستانه رفتاری نزدیکتر است و پس از این فرکانس به ترتیب فرکانس‌های ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ هرتز قرار دارند.

در آزمون ASSR در هر دو فرکانس مدولاسیون، ضریب همبستگی نشان‌دهنده ارتباط قوی بین این آزمون و PTA است. این میزان در فرکانس‌های ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۴۰۰۰ هرتز در ASSR با ۴۰ هرتز به ترتیب ۰/۹۳۶، ۰/۹۳۲ و ۰/۹۵۱ است و در ASSR با ۸۰ هرتز به ترتیب ۰/۹۲۸، ۰/۹۱۰ و ۰/۹۴۷ است.

با افزایش فرکانس، ضریب همبستگی به غیر از فرکانس ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ هرتز که کاهش می‌یابد، در بقیه موارد (بعد از فرکانس ۱۰۰۰ هرتز) افزایش می‌یابد و به طور کلی در تمامی فرکانس‌ها ضریب همبستگی در ASSR با ۴۰ هرتز بالاتر از ASSR با ۸۰ هرتز است. در فرکانس‌های پایین نیز بین ASSR و PTA همبستگی مطلوبی وجود دارد که این نتیجه مشابه برخی از تحقیقات است(۱۴و۱۵). اما با برخی تحقیقات مغایرت دارد(۱۶). دلیل عدمه این تفاوت استفاده از نمونه‌های متفاوت است. در برخی تحقیقات ذکر شده میزان کم شنوازی مورد ارزیابی بالاتر از سطح کم شنوازی متوسط بوده است که این عامل می‌تواند

REFERENCES

1. Sininger YS, Threshold prediction using auditory brainstem response and steady-state evoked potentials with infants and young children in: Katz J, editor. Handbook of Clinical Audiology, 5th ed. Baltimore: Lippincott William & wilkins; 2002. p.298-323.
2. John MS, Brown DK, Muir PJ, Picton TW. Recording auditory steady-state responses in
- John MS, Brown DK, Muir PJ, Picton TW. Recording auditory steady-state responses in young infants. Ear Hear. 2004;25(6):539-53.
3. Vander Werff KR, Brown CJ. Effect of audiometric configuration on threshold and suprathreshold auditory steady state response. Ear Hear. 2005;26(3):310-26.
4. Petitot C, Collet L, Durrant JD. Auditory steady state responses (ASSR): effect of

- modulation and carrier frequencies. *Int J Audiol.* 2005;44:567-73.
5. Markessis E, Poncelet L, Colin C, Coppens A, Hoonhors TI, Deggouj N, et al. Auditory steady state evoked potentials (ASSEPs): A study of optimal stimulation parameters for frequency-specific threshold measurement in dogs, *Clin Neurophysiol.* 2006;117(8):1760-71.
 6. Van Maanen A, Stapells DR. Comparison of multiple auditory steady-state responses (80 versus 40 Hz) and slow cortical potentials for threshold estimation in hearing-impaired adults. *Int J Audiol.* 2005;44:613-24.
 7. Mueller HG, Bright KE. Monosyllabic procedures in central testing. In: Katz J, editor. *Handbook of Clinical Audiology*. 4th ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1994.p.222-38.
 8. Picton TW. Audiometry using steady-state response in: Burkard R, Don M, Eggermont J, editors. *Auditory evoked potentials, basic principle and clinical application*. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins; 2007.p. 441-63.
 9. Aoyagi M, Suzuki Y, Yokota M, Furuse H, Watanabe T, Ito T. Reliability of 80-Hz amplitude-modulation-following response detected by phase coherence. *Audiol Neurotol.* 1999;4(1):28-37.
 10. Ballay C, Tonini R, Waninger T, Yoon C, Manolidis S. Steady-state response audiometry in a group of patients with steeply sloping sensorineural hearing loss. *Laryngoscope.* 2005;115(7):1243-6.
 11. Scherf F, Brox J, Wuyts FL, Van de Heyning PH. The ASSR: clinical application in normal-hearing and hearing-impaired infants and adults, comparison with the clik-evoked ABR and pure-tone audiometry. *Int J Audiol.* 2006;45(5):281-6.
 12. Kaf WA, Durrant JD, Sabo DL, Robert Boston J, Taubman LB, Kovacyk K. Validity and accuracy of electric response audiometry using the auditory steady-state response: evaluation in an empirical design, *Int J Audiol.* 2006;45:211-23.
 13. Kaf W, Sabo D, Durrant J, Rubinstein E. Reliability of electric response audiometry using 80Hz auditory steady-state responses. *Int J Audiol.* 2006;45:477-86.
 14. Lins OG, Picton TW, Boucher BL, Durieux-Smith A, Champagne SC, Moran LM et al. Frequency-specific audiometry using steady-state responses. *Ear Hear.* 1996;17(2):81-96.
 15. Lins OG, Picton TW. Auditory steady-state responses to multiple simultaneous stimuli. *Electroencephalogr Clin Neurophysiol.* 1995;96(5):420-32.
 16. Luts H, Desloovere C, Kumar A, Vandermeersch E, Wouters J. Objective assessment of frequency-specific hearing thresholds in babies. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol.* 2004;68(7):915-26.