

دیجیتال سابتراکشن تصاویر رادیوگرافی

با استفاده از کامپیوتر شخصی و نرم افزارهای عادی مخصوص اسکنرها

دکتر عیسی مظفری

چکیده

هدف از انجام دیجیتال سابتراکشن تصاویر رادیوگرافی حذف سایه های اضافی جهت افزایش وضوح و کیفیت تصویر می باشد. در دندانپزشکی می توان از تکنیک دیجیتال سابتراکشن برای تشخیص بیماری های پریودontal پیشرونده یا بررسی میزان ترمیم یا تخریب استخوان فکین استفاده نمود. در این پژوهش امکان انجام دیجیتال سابتراکشن با روشهای ارزان قیمت توسط کامپیوتر شخصی را بررسی کردہ ایم. جهت انجام این کار ابتدا تصاویر اولیه رادیوگرافی را تهیه نموده، سپس آنان را توسط اسکنر داخل کامپیوتر دیجیتايز نمودیم. در ادامه، عمل سابتراکشن را روی دو نرم افزار قابل دسترس مخصوص اسکنرها که در آنان امکان انجام دیجیتال سابتراکشن وجود داشت آزمایش کردیم. نتایج حاصل از این پژوهش در مقاله بحث شده است.

مقدمه و تاریخچه

برای آن در نظر گرفته شده است.^{(۱) و (۲)} در دندانپزشکی، استفاده از تکنیک دیجیتال سابتراکشن هنوز در مراحل مقدماتی و تحقیقاتی است، ولی به نظر می رسد که می توان از آن برای تشخیص و بررسی کمی بیماری های پریودontal پیشرونده (هوع)، همچنین بررسی میزان ترمیم استخوان فکین پس از عمل جراحی یا تحلیل استخوان فکین و مفصل گیجگاهی در اثر ضایعات و بیماری ها، استفاده نمود (^{۳ و ۴} و ^{۵ و ۶} و ^{۷ و ۸} و ^{۹ و ۱۰}). بعلاوه با توجه به اینکه در سیالوگرافی نیز از ماده حاجب برای نشان دادن تغییرات مجاری غدد بزاقی استفاده می شود لذا می توان از دیجیتال سابتراکشن برای مشخص تر کردن تغییرات ریز بخصوص در شاخه های فرعی غدد بزاقی

تکنیک دیجیتال سابتراکشن یا کسر کامپیوترا در رادیولوژی برای حذف سایه ها و تصاویر اضافی (که باعث کاهش وضوح تصویر می شوند) بکار می رود. بعبارت دیگر حذف این سایه ها موجب بارز و مشخص تر شدن جزئیات مورد نظر در تصویر گشته و در نتیجه باعث افزایش قدرت تشخیصی می گردد.^(۱) تکنیک سابتراکشن تصاویر رادیوگرافی بدون استفاده از کامپیوترا برای اولین بار در سال ۱۹۳۵ توسط Ziedses Des Plantes مطرح گردید.^(۲) ولی تکنیک دیجیتال سابتراکشن بوسیله کامپیوترا (DSR^{***}) و بصورت امروزی از اواخر دهه هفتاد میلادی و پس از معرفی دستگاه های DSA^{****} جای خود را در تشخیص رادیولوژی باز کرد. در سالهای اخیر در مورد کاربرد این تکنیک در پزشکی مطالعات زیادی انجام گرفته است که با توجه به نتایج حاصله موارد استفاده فراوانی

* استاد بخش رادیولوژی و تشخیص دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

* * Digital Subtraction Radiography

* * * Digital Subtraction Angiography

گرافیکی مخصوص، بداخل کامپیوتر دیجیتایز کرد. علت انتخاب این نوع اسکن برای انجام این پروژه این بود که بتوانیم تصاویری که از رنگهای سیاه و سفید با سایه‌های خاکستری تشکیل شده‌اند را با کیفیت خوب و مشابه با اسکنرهای گرانقیمت مخصوص فیلم‌های رادیوگرافی، دیجیتایز نمائیم. ولی از آنجاتیکه نور این نوع اسکن برای دیجیتایز کردن تصاویر چاپی و اسکن کردن نوشته کتب و مجلات تنظیم شده، لذا برای دیجیتایز کردن تصاویر رادیوگرافی توسط آن، ابتدا منبع نور اسکن را بصورتی جایگزین کردیم که تصویر پس از عبور نور از فیلم رادیوگرافی دیجیتایز شود و نه پس از انعکاس از سطح فیلم برای جایگزینی نور اسکن از تجربیات یک تحقیق دیگر که شرح آن بصورت یک مقاله جهت چاپ ارسال کرده‌ایم استفاده نمودیم.^(۲۱)

ب- روش کار

برای کاهش تاثیر متغیرها، این مطالعه را بدوبخش تحقیق بصورت *Invitro* و *Invivo* تقسیم نمودیم.

۱- دیجیتال سابتراکشن تصاویر شبه سیالوگرام بصورت *Invitro*

ابتدا یک جمجمه خشک را در داخل وسیله نگاهدارنده قرارداده و آنرا در موقعیت تکنیک True Lateral ثابت کردیم. سپس کیلوولت و میلی‌آمپر دستگاه را روی یک عدد ثابت تنظیم نموده و رادیوگرافی اول را تهیه کردیم. برای تهیه رادیوگرافی دوم، مقداری یوروگرافین ۶۰ درصد را توسط سرنگ بداخل لوله آنجیوکت کشیده و آنرا روی استخوان راموس ماندیل و قسمتی از ماکزیلا قرار دادیم. در اینحالت فاکتورهای جنبی، مثل فاصله نوک تیوب دستگاه تا فیلم، میزان کیلوولت و میلی‌آمپر دستگاه، زمان تابش اشعه، زاویه تابش اشعه، دمای داروی ظهور و ثبوت، نوع فیلم رادیوگرافی و

نیز استفاده کرد.^(۱۲) در حال حاضر روش دیجیتال سابتراکشن بیشتر در آنجیوگرافی بکار برده می‌شود. بهمین دلیل ساختار دستگاههای دیجیتال سابتراکشن موجود، اغلب براین اساس و همچنین براساس تولید تصاویر متعدد در مدت زمان کوتاه طراحی شده‌اند^(۱۳) که در نتیجه علاوه بر بالابودن قیمت آنها، برای استفاده در دندانپزشکی مناسب نمی‌باشد.

تحقیق برای انجام دیجیتال سابتراکشن در زمینه دندانپزشکی توسط کامپیوترهای شخصی از چند سال قبل شروع شده و در این مورد گزارش‌های متعددی وجود دارد^{(۱۴) و (۱۵)} و در این هنوز نرم‌افزار خاصی برای منظور که قابل استفاده در کامپیوترهای شخصی باشد، برای استفاده عموم ارائه نشده است. لذا در این پژوهش با استفاده از نرم‌افزارهای ارزانقیمت موجود که معمولاً عنوان نرم‌افزارهای مخصوص اسکنرهای عادی عرضه می‌شوند، امکان انجام دیجیتال سابتراکشن با کامپیوترهای شخصی را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

مواد و روش کار

الف- مواد

مواد و تجهیزات مورد استفاده در این تحقیق عبارت بودند از:


۱- دستگاه رادیوگرافی دندانپزشکی.

۲- یک کامپیوتر با پروسسور مرکزی از نوع DXII66، هشت مگابایت حافظه برای افزایش سرعت انتقال داده‌ها و ۲۵۰ مگابایت دیسک هارد برای ضبط و ذخیره کردن تصاویر.

۳- نرم‌افزارهای Photostyler LE و Photomagic برای انجام دیجیتال سابتراکشن.

۴- یک اسکنر صفحه‌ای (Page Scanner) با رزولوشن ۱۰۰ تا ۱۲۰۰ دیجی آی (نقطه در اینچ) و قدرت دریافت بیش از ۲۵۶ درجه خاکستری (256 Grey Scale) جهت اسکن کردن تصاویر رادیوگرافی.

تصاویر رادیوگرافی را می‌توان بكمک اسکنر یا دیجیتایزرهای مخصوص فیلم رادیوگرافی یا بكمک دوربين ویدئو باکارت

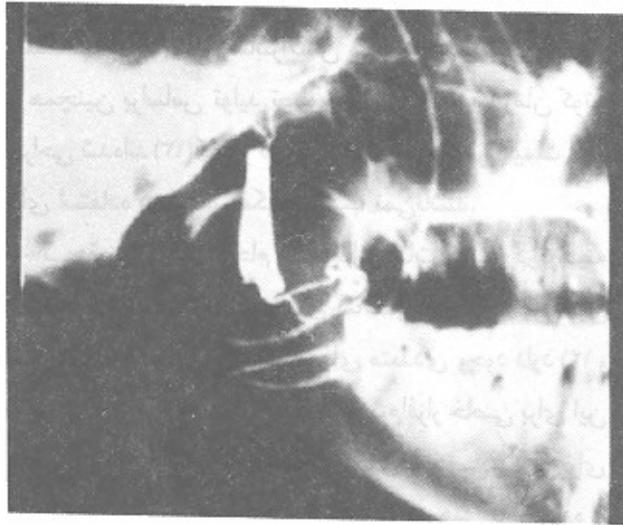


تصویر شماره ۲ - تصویر رادیوگرافی دیجیتايز شده جمجمه خشک پس از اضافه کردن ماده حاجب که عنوان تصویر دوم از آن استفاده شده است.

۲- انجام دیجیتال سابتراکشن بصورت Invivo

برای انجام این کار، ابتدا یک جعبه با سطح شبیدار بصورت بوکی، چهت ثابت نگاه داشتن سریمار و تنظیم زاویه تیوب دستگاه تهیه کردیم. جعبه بصورتی ساخته شده بود که بما اجزاء می‌داد بدون تغییر موقعیت سریمار و تیوب دستگاه، بتوانیم کاستهای رادیوگرافی را عوض کرده، یا در صورت لزوم هر دو تصویر را روی یک فیلم ظاهر کنیم. این قسمت از کار از اهمیت خاصی برخوردار بود، چراکه هرگونه جابجایی سریمار یا تغییر زاویه تیوب دستگاه رادیوگرافی حین گرفتن دو رادیوگرافی، باعث باقیماندن سایه‌های ناخواسته روی تصویر سابتراکت شده گشته و از کیفیت تصویر نهانی می‌کاست. سپس پنج بیمار را که بعلت ناراحتی غده بزاوی اصلی برای انجام سیالوگرافی مراجعه نموده بودند برای این کار در نظر گرفتیم. برای انجام کار ابتدا یک رادیوگرافی از نوع مایلی

صفحه تشیدکننده مورد استفاده) را ثابت نگاه داشتیم تا فاکتورهای کنترل کننده هر دو تصویر مساوی باشند. خمنا برای حذف اثر داروی ظهور و ثبوت، هر دو تصویر را روی یک فیلم قرار دادیم تا بطور مساوی ظاهر شوند. لذا تصویر دوم از همه نظر بجز از نظر سایه ماده حاجب اضافه شده، با تصویر اول مساوی بود. سپس تصاویر رادیوگرافی را با اسکنر بداخل کامپیوتر دیجیتايز کرده و برای انجام عمل دیجیتال سابتراکشن از دو نرم افزار برنامه‌ای Photomagic LE ، و Photostyler که جزء نرم افزارهای مخصوص اسکنرها بوده و معمولاً برای روتونش یا تغییر تصاویر فتووگرافی مورد استفاده قرار می‌گیرند، استفاده نمودیم. در ادامه تصاویر را با تشکل Graphics Interchange Format (Gif) که به اختصار Gif نامیده می‌شود، روی دیسک سخت کامپیوتر ضبط نمودیم. (تصویر شماره ۱ تصویر رادیوگرافی دیجیتايز شده جمجمه خشک بدون ماده حاجب است که عنوان ماسک در نظر گرفته شد و تصویر شماره ۲، تصویر رادیوگرافی دیجیتايز شده همان جمجمه پس از اضافه کردن ماده حاجب می‌باشد).

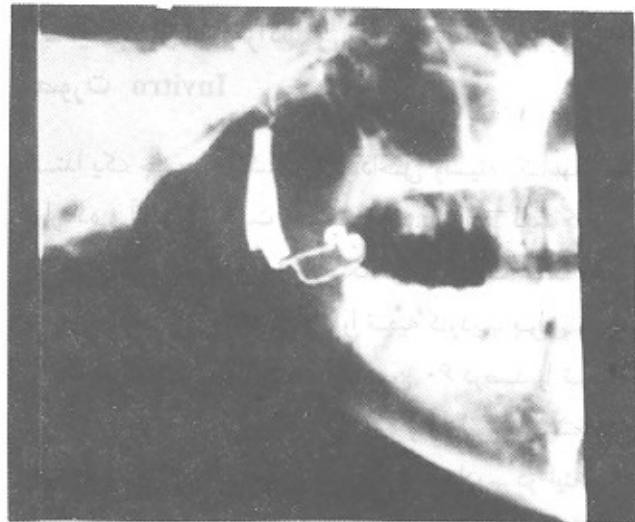

تصویر شماره ۱ - تصویر دیجیتايز شده رادیوگرافی جمجمه خشک بدون ماده حاجب که عنوان تصویر ماسک در نظر گرفته شده است.

نظر در دو تصویر وجود داشت، ولی برای سابتراکت کردن تصاویر می‌بایست چاره‌ای می‌اندیشیدیم. جهت انجام این کار دو تصویر را بصورتهای متفاوت روی هم قرار داده و آزمایش کردیم تا اینکه بالاخره بصورت زیر توانستیم عمل دیجیتال سابتراکشن را با این نرمافزار، انجام دهیم. در این روش، ابتدا یکی از تصاویر را بعنوان ماسک (Mask) انتخاب کرده (تصویر شماره ۱) و سپس تصویر دیگر (تصویر شماره ۲) را پس از تبدیل بهالت مثبت، روی تصویر ماسک منطبق نمودیم. بعد از انطباق صحیح دو تصویر روی یکدیگر، آنها را بصورت نیمه شفاف (Semi-transparent) در آوردیم تا نقاط مشابه در دو تصویر خنثی شوند و در نتیجه نقاط متفاوت مورد نظر واضح‌تر دیده شوند. سپس در صورت نیاز میزان کانتراست تصویر را زیادکرده تا تصویر واضح‌تر شود. تصویر شماره ۱، تصویر اولیه از جمجمه خشک است که بعنوان تصویر ماسک در نظر گرفتیم، تصویر شماره ۲ تصویر همان جمجمه پس از اضافه کردن ماده حاجب‌می‌باشد. (تصویر شماره ۳)، نتیجه انجام عمل سابتراکشن توسط نرم‌افزار Photomagic LE می‌باشد. همانطور که ملاحظه می‌شود، عمل سابتراکشن بعلت داشتن امکان تطابق بیشتر تصاویر اولیه روی یکدیگر، بخوبی صورت گرفته و در نتیجه تصویر سابتراکت شده از کیفیت مناسبی برخوردار است. عمل سابتراکشن با نرم‌افزار Photostyler بعلت عدم تطابق کامل دو تصویر اولیه روی یکدیگر، بخوبی انجام نگرفت. بهمین دلیل تصویر حاصله بعلت کیفیت نامناسب چاپ نشده است.

ب - نتیجه آزمایش بصورت Invivo

در این قسمت از پژوهش، از سیالوگرام پنج بیمار برای انجام دیجیتال سابتراکشن استفاده نمودیم که برای کاهش حجم مطلب، تنها نتیجه یک نفر از بیماران را بعنوان نمونه در این مقاله ارائه کرده‌ایم. ضمناً بدلیل نتایج بدست آمده در آزمایش Invitro، عمل دیجیتال سابتراکشن را تنها با نرم‌افزار

جانبی (Latral Oblique) از فک هر بیمار تهیه نمودیم. در ادامه ماده حاجب را بدون تغییر دادن موقعیت سریبیمار و تیوب رادیوگرافی، بداخل غده تزریق نموده و یک رادیوگرافی مشابه قبل تهیه نمودیم (تصویر شماره ۴ مربوط به همان بیمار پس از تزریق ماده حاجب می‌باشد). برای انجام دیجیتال سابتراکشن با توجه به نتایج بدست آمده از آزمایش Invitro، تنها از نرم‌افزار Photomagic LE و با روش کسر ماسک (Mask Subtraction)، برای این کار استفاده نمودیم.

نتایج

نتایج را براساس اینکه آزمایش روی جمجمه خشک یا روی انسان انجام شده، به دو قسمت Invivo و Invitro تقسیم کرده‌ایم.


الف - نتایج آزمایش Invitro

در این مرحله از پژوهش، عمل دیجیتال سابتراکشن را توسط دو نرم‌افزار Photostyler و Photomagic LE انجام دادیم. در نرم‌افزار Photostyler یک دستور از قبل تعیین شده سابتراکت وجود داشت که ما از این دستور برای انجام دیجیتال سابتراکشن استفاده نمودیم. استفاده از این نرم‌افزار بخارط وجود این دستور که بصورت Batch File (فایل دسته‌ای) عمل می‌کرد و بعبارت دیگر عمل سابتراکشن را بطور اتوماتیک انجام می‌داد، باعث افزایش سرعت کار می‌گردید. ولی از آنجائیکه امکان تصحیح زوایا و انطباق کامل دو تصویر روی یکدیگر وجود نداشت، لذا عمل سابتراکشن در صورت وجود حتی تفاوت‌های جزئی در دو تصویر، بخوبی انجام نمی‌گرفت و در نتیجه تصویر سابتراکت شده از کیفیت مطلوبی برخوردار نبود. در نرم افزار Photomagic LE دستور مشخص سابتراکشن وجود نداشت، ولی در عوض می‌توانستیم دو تصویر را بدلخواه روی هم منطبق کنیم. بهمین دلیل امکان تصحیح اختلاف زاویه تا چند درجه و انطباق قسمتهای مورد

انجام دادیم. (تصویر شماره ۴، تصویر رادیوگرافی دیجیتايز شده از نوع لاترال آبلیک (مايلی جانبی) بيماري است که بعلت ناراحتی غده بزاقي تحت فکی برای انجام سیالوگرافی مراجعه نموده بود. تصویر شماره ۵، تصویر ساپتراکت شده همین بيمار توسط نرمافزار Photomagic LE می باشد. همانطور که ملاحظه می شود، تصویر غده بزاقي بطوط بارز و مشخص تر دیده می شود. (تصویر شماره ۶) همان تصویر شماره ۵ با درستمياني بيشتر می باشد. (تصویر شماره ۷ و ۸) نيز حاصل يك سري عمليات کامپيوتری روی همین تصویر يكمک نرمافزار کامپيوتری Photostyler می باشد. همانطور که ملاحظه می شود می توان با تعیير سایه خاکستری تصاویر، مناطق مورد نظر را واضحتر نمود. البته باید توجه داشت که انجام اين کار ممکن است باعث از بین رفتن اطلاعات در قسمتهای ديگر تصویر گردد.

بحث


انجام دیجیتال ساپتراکشن در دندانپزشکی می تواند به تشخيص بيماريهاي پريودونتال پيش رونده يا بررسی ميزان

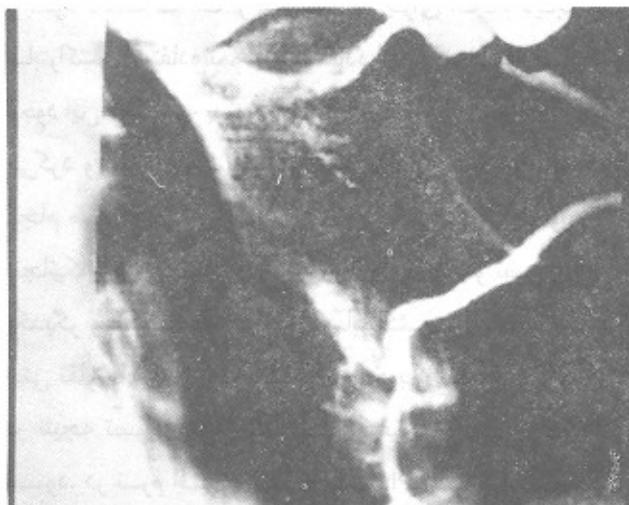


تصویر شماره ۵ - اين تصویر، تصویر ساپتراکت شده يكى از بيماران توسط نرمافزار Photomagic LE می باشد. همانطور که ملاحظه می شود، تصویر غده بزاقي بطوط بارز و مشخص تر دیده می شود.




تصویر شماره ۳ - اين تصویر نتيجه انجام عمل ساپتراکشن توسط نرمافزار Photomagic LE می باشد. همانطور که ملاحظه می شود، عمل ساپتراکشن بعلت داشتن امكان تطابق بيشتر تصاویر اوليه روی يكديگر، بخوبی صورت گرفته و در نتيجه تصویر ساپتراکت شده از كيفيت مناسبی برخوردار است.

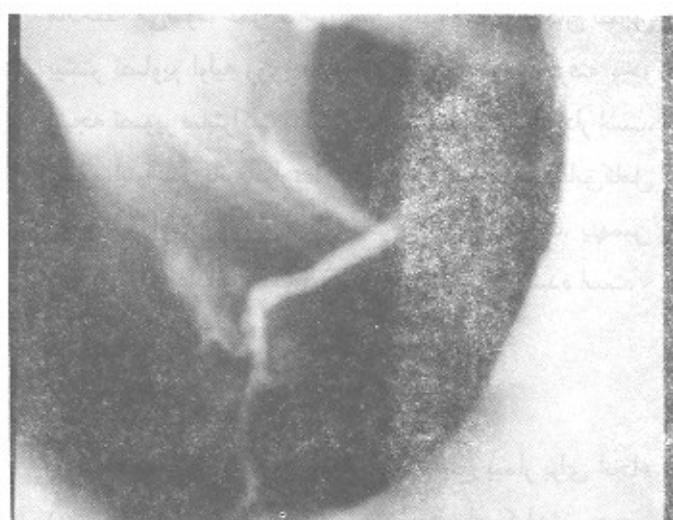

تصویر شماره ۴ - تصویر رادیوگرافی دیجیتايز شده از نوع لاترال آبلیک (مايلی جانبی) بيماري است که بعلت ناراحتی غده بزاقي تحت فکی برای انجام سیالوگرافی مراجعه نموده بود. از اين تصویر بعنوان تصویر ماسک استفاده شد.

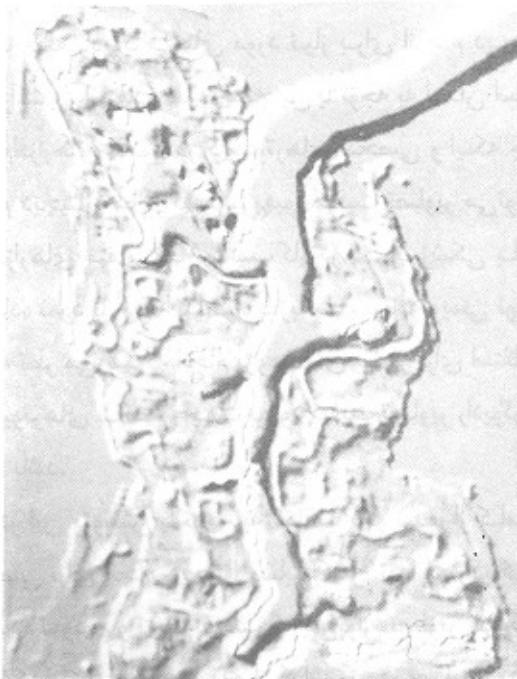

تصویر شماره ۸- پس از انجام دستور کامپیوتري امباس (Emboss) روی تصویر شماره ۷ بدست آمده است.

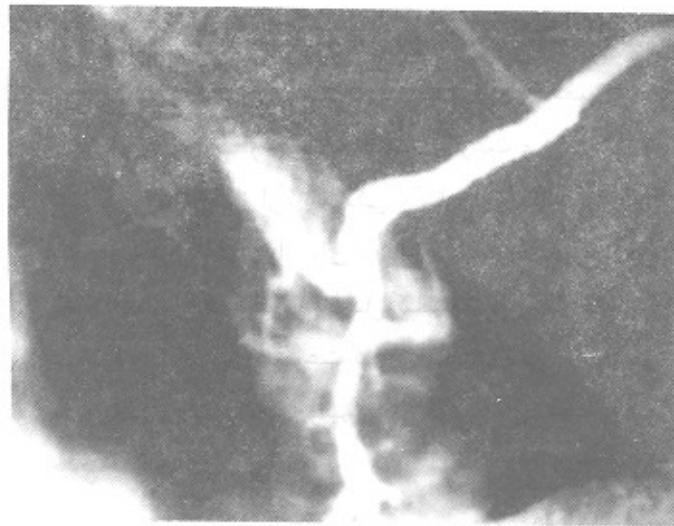

تصویر شماره ۶- این تصویر همان تصویر شماره ۵ با درشتمنانی بيشتر می باشد.

ترمیم ضایعات پس از عمل جراحی و احياناً میزان تخریب ضایعات استخوان فکین و مفصل گیجگاهی، کمک کند. ما در این پژوهش نتیجه گرفتیم که برای انجام دیجیتال سابتراکشن در دندانپزشکی، نیازی به داشتن دستگاههای گرانقیمت DSA وجود ندارد. بعلاوه با توجه به اینکه اینگونه دستگاهها برای منظورهای خاص مثل آنژیوگرافی طراحی شده‌اند، لذا استفاده از آنها در دندانپزشکی مقرن به صرفه نیست. در آنژیوگرافی با توجه به سرعت جریان خون، فاکتور زمان اهمیت زیادی دارد. لذا برای انجام دیجیتال سابتراکشن تصاویر آنژیوگرافی، نیاز به دستگاههای وجود دارد که قادر به گرفتن رادیوگرافی‌های متعدد در فواصل کوتاه بوده و در مقابل گرمای حاصله مقاوم باشد. این در حالیست که در رادیولوژی مورد استفاده دندانپزشکی و حتی سیالوگرافی، نیازی به تهیه تصاویر متعدد در فاصله زمانی کوتاه وجود ندارد. بعبارت دیگر می‌توان از دستگاههای رادیوگرافی معمولی دندانپزشکی



تصویر شماره ۷- این تصویر حاصل يك سري عملیات کامپیوتري روی تصویر شماره ۶ می باشد که بهمکن نرم افزار Photostyler انجام گرفته است. همانطور که ملاحظه می شود می توان با تغییر سایه خاکستری تصاویر، مناطق مورد نظر را واضح تر نمود.

مقاصد دیگر ساخته شده‌اند و این باعث کاهش سرعت کار می‌گردد، لذا به نظر می‌رسد که تهیه یک نرمافزار مخصوص با قابلیتهای مورد نظر جهت افزایش سرعت و دقت کار و استفاده همگانی از آن، بسادگی امکان‌پذیر باشد. بعلاوه چنانچه وسایل مورد نیاز برای ارسال مستقیم تصاویر (بدون واسطه فیلم رادیودگرافی)، بداخل کامپیوتر را تهیه نماییم، علاوه بر افزایش سرعت کار و کاهش تغییر زاویه در رادیوگرافیهای متعدد، می‌توانیم تأثیر عوامل تاریکخانه را نیز حذف نماییم.

نتیجه

از این پژوهش نتیجه گرفتیم که امکان انجام دیجیتال سایبریاکشن و بهبود کیفیت تصاویر رادیوگرافی با کامپیوترهای شخصی و با روش‌های ارزان قیمت در ایران وجود دارد ولی می‌باید روی روش‌های متفاوت از جمله ارسال مستقیم تصاویر رادیوگرافی بداخل کامپیوتر و ساخت یک نرمافزار مناسب جهت افزایش سرعت کار تحقیق شود.

جهت تهیه رادیوگرافی‌های مورد نیاز برای انجام دیجیتال سایبریاکشن، استفاده نمود. همچنین با توجه به امکان استفاده از نرمافزارهای متنوع در کامپیوترهای شخصی و اینکه جهت انجام دیجیتال سایبریاکشن یا بهبود کیفیت تصاویر می‌توان از نرمافزارهای متفاوت که مناسب کار در دندانپزشکی باشند، استفاده نمود یا آنها را بدلخواه با زبانهای برنامه‌نویسی نوشت، لذا به نظر می‌رسد که انجام پژوهش‌های بیشتر برای استفاده از کامپیوترهای شخصی جهت بهبود کیفیت تصاویر رادیوگرافی، مفید باشد.

در این پژوهش با توجه به مطالب ذکر شده، از کامپیوتر شخصی برای انجام دیجیتال سایبریاکشن تصاویر رادیوگرافی استفاده نمودیم و نتیجه گرفتیم که می‌توان تصاویر رادیوگرافی را با کیفیت مطلوب، بداخل کامپیوتر دیجیتايزر کرد و از نرمافزارهای متعدد قابل دسترس که معمولاً همراه اسکنرها بفروش می‌رسند برای انجام دیجیتال سایبریاکشن و کنترل کاتراست، دانسیته و رنگ قسمتهای متفاوت تصویر، استفاده نمود. با این وجود با توجه به اینکه اینگونه نرمافزارها برای

REFERENCES

1. Goaz, P.W. and White, S.C: 1994. *Oral Radiology, Principles and Interpretation.* 3rd ed. 1 Mosby: 274-275.
2. Jeans W.D: 1990. The development and use of digital subtraction radiography. *British J of Radiol.* March, 63(747): 161-67.
3. Dunnik, N R.; Svetkey, L P.; Cohan, R.H., [etal]. 1989. Intravenous digital subtraction renal angiography: use inscreening for renovascular hypertension. *Radiology.* April; 171(1) : 219-22.
4. Trigux, J.P.; Delchamber, F.; Beers, B. V: 1990. Anatomical variations of the carotid bifurcation: Implications for digital subtraction angiography and ultrasonography. *British J of Radiol.* March; 63 (747): 181-58.
5. Wenzel, A.; Warrer, K. and Karring, T: 1992. Digital subtraction radiography in assessing bone changes in periodontal defects following guided tissue regeneration. *J Clin Periodontol.* 19: 208-213.
6. Benn, D.K: 1990. Limitations of digital image subtraction technique in assessing alveolar bone crest change due to misalignment errors duringimage capture. *Dentomaxillofac. radiol.* Aug; 19:97-104.
7. Southard, Karin A.; Southard, Thomas E: 1994. Detection of simulated osteoporosis in dog alveolar bone with the use of digital subtraction. *Oral Surg. Oral Med. Oral pahol.* 77:412-8.
8. Katsarsky, J. W; Levin, M.S; Allen, K.M. etal. 1994. Detection of experimentally induced lesions in subtraction images of cancellous alveolar bone. *Oral Surg. oral Med. Oral Pathol.* 77:674-7.
9. Engelke, W.; Ruttimann E.; Tsuchimochi, M. and Bacher, J.D. 1992 An experimental study of new diagnostic methods for the examination of osseous lesions in the temporomandibular joint. *Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol.* 73 384-9.
10. Prepanpoch, S.; Langlais, R. P.; Dove, S. B. K. [etal] 1993 Digital subtraction temporomandibular joint tomography. *Oral Surg., Oral Med., Oral pathol.* Jan; 75(1): 122-34.
11. kapa, S.F.; [etal] 1993. Assessing condylar changes with digital subtraction radiography. *Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol.* 75:247-52.
12. Hgit, E. T.; Cizmeli, O.; Isik, S. [etal] 1992. Digital. subtraction sialography: technique, advantages and results in 107 cases. *European Journal of Radiology.* 15: 244-247.
13. Curry, T.S.; Dowdley, J.E.; Murry, R.C. *Christensen's Physics of Diagnostic Radiology.* pp. 415-427.
14. Halse, A.; odont, Espelid I.; Bjorg, A. [etal] 1994. Detection of mineral loss in appriximal enamel by subtraction radiography. *Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol.* 77:177-82.
15. Ludlow, J.B. and Peleaux, C. P; 1994. Comparsion versus laser- and cephalostat-aligned periapical film - pisioning techniques for use in digital subtraction radiography. *Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol.* 77: 208-15.
16. Samarabandu, J.; Allen K.M; Hausmann, E.; Acharya, R: 1994. Algorithm for the autmoated alignment of radiographs for image subtraction. *Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol.* 77:75-9.
17. Araki K. H. Yoshjura, K. K; Okuda, H. and Ohki, M: 1992. Standardized lateral oblique projection of the mandible for digital subtraction raiography. *Dentomaxillofac Radiol.* 21: 88-91.

REFERENCES

1. Goaz, P.W. and White, S.C: 1994. *Oral Radiology, Principles and Interpretation*. 3rd ed. 1 Mosby: 274-275.
2. Jeans W.D: 1990. The development and use of digital subtraction radiography. *British J of Radiol*. March, 63(747): 161-67.
3. Dunnik, N R.; Svetkey, L P.; Cohan, R.H., etall.1989. Intravenous digital subtraction renal angiography: use inscreening for renovascular hypertension. *Radiology*. April; 171(1) : 219-22.
4. Trigux, J P.; Delchamber, F.; Beers, B. V: 1990. Anatomical variations of the carotid bifurcation: Implications for digital subtraction angiography and ultrasonography. *British J of Radiol*. March; 63 (747): 181-58.
5. Wenzel, A.; Warrer, K. and Karring, T: 1992. Digital subtraction radiography in assessing bone changes in periodontal defects following guided tissue regeneration. *J Clin Periodontol*. 19: 208-213.
6. Benn, D.K: 1990. Limitations of digital image subtraction technique in assessing alveolar bone crest change due to misalignment errors duringimage capture. *Dentomaxillofac. radiol*. Aug; 19:97-104.
7. Southard, Karin A.; Southhrd, Thomas E: 1994. Detection of simulated osteoporosis in dog alveolar bone with the use of digital subtraction. *Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol*. 77:412-8.
8. Katsarsky, J. W; Levin, M.S; Allen, K.M. etal. 1994. Detection of experimentally induced lesions in subtraction images of cancellous alveolar bone. *Oral Surg. oral Med. Oral Pathol*. 77:674-7.
9. Engelke, W.; Ruttimann E.; Tsuchimochi, M. and Bacher, J.D. 1992 An experimental study of new diagnostic methods for the examination of osseous lesions in the temporomandibular joint. *Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol*. 73 384-9.
10. Prepanpoch, S.; Langlais, R. P.; Dove, S. B. K. etal 1993 Digital subtraction temporomandibular joint tomography. *Oral Surg., Oral Med., Oral pathol*. Jan; 75(1): 122-34.
11. kapa, S.F.; Tyndall, D. A.; Zullo, T. G. and Bagnell C. R: 1993. Assessing condylar changes with digital subtraction radiography. *Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol*. 75:247-52.
12. Hgit, E. T.; Cizmeli, O.; Isik, S. etal 1992. Digital. subtraction sialography: technique, advantages and results in 107 cases. *European Journal of Radiology*. 15: 244-247.
13. Curry, T.S.; Dowdey, J.E.; Murry, R.C. *Christensen's Physics of Diagnostic Radiology*. pp. 415-427.
14. Halse, A.; Dr odont, Espelid I.; Bjorg, A. etal 1994. Detection of mineral loss in appriximal enamel by subtraction radiography. *Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol*. 77:177-82.
15. Ludlow, J.B. and Peleaux, C. P: 1994. Comparsion versus laser- and cephalostat-aligned periapical film - positioning techniques for use in digital subtraction radiography. *Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol*. 77: 208-15.
16. Samarabandu, J.; Allen K.M; Hausmann, E.; Acharya, R: 1994. Algorithm for the autmoated alignment of radiographs for image subtraction. *Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol*. 77:75-9.
17. Araki K. H. Yoshjura, K. K; Okuda, H. and Ohki, M: 1992. Standardized lateral oblique projection of the mandible for digital subtraction raiography. *Dentomaxillofac Radiol*. 21: 88-91.

18. Wenzel, A. and Sewerin, Ib: 1991. Sources of noise in digital subtraction radiography. *Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol.* 71:503-8.
19. Ludlow, J. B.; Soltmann, R.; Tyndall, D. et al 1991. Digitally subtracted linear tomograms: Three techniques for measuring condylar displacement. *Oral Surg. Oral Med. Oral pathol.* Nov., 72(5): 614-20.
20. Tyndall, D. A.; Trahey, A M.; Rener, J: 1991. Validity of digital subtraction of transcranial plain films in quantification of positional changes of the mandibular condyle. *Oral Surgl Oral Med. Oral pathol.* june, 71(6): 748-55.
21. Mozaffari, E: A method of digitizing Radiographic Images by ordinary hand scanners.
Recently sent for publication.

۲۲. دیجیتايز کردن تصاویر رادیوگرافی با اسکنرهای دستی معمولی)