

بررسی و مقایسه ای سطوح ایمنی دز موثر تیروئید و چشم در سی تی اسکن جمجمه، با استفاده از دستگاه های مولتی اسالایس

دکتر وحید چنگیزی^۱، فرشته محمدی^۲، دکتر علی ابراهیمی نیا^{۳*}

چکیده

زمینه و هدف: سی تی اسکن یک روش تصویربرداری با دز بالاست و در سی تی اسکن جمجمه، چشم و تیروئید دو عضو حساس به پرتو هستند. در این مطالعه دز موثر چشم و تیروئید بیماران با استفاده از دزیمتر ترمولومینسانس (TLD) ارزیابی شده اند.

روش بررسی: این مطالعه توصیفی تحلیلی در سه بیمارستان با سه نوع دستگاه بنام های GE مدل ۲ اسالایس (کد ۱)، GE مدل ۸ اسالایس (کد ۲)، Siemens مدل ۱۶ اسالایس (کد ۳) انجام شد. تعداد ۵۱ نمونه از بیمارستان های منتخب شهر رشت در شهریور و مهر سال ۱۳۹۵ با استفاده از TLD جمع آوری گردید. پس از کالیبراسیون TLD ها در مرکز کالیبراسیون، این دزیمترها بر روی پلک و تیروئید بیماران قرار داده شد و میانگین دز موثر دریافتی چشم و تیروئید این بیماران در طول آزمون سی تی اسکن جمجمه بررسی شد. داده ها با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل و نتایج با استفاده از آزمون واریانس (ANOVA) $P < 0.05$ انجام شد.

یافته ها: متوسط دز موثر دریافتی چشم و تیروئید بیماران در بیمارستان با کدهای ۱ و ۲ و ۳ به ترتیب $2/66 \pm 2/04$ mSv، $0/03 \pm 0/09$ mSv، $0/02 \pm 0/11$ mSv و $0/02 \pm 0/01$ mSv، $1/94 \pm 0/95$ و $0/04 \pm 0/01$ گزارش شد. اختلاف معناداری میان دز موثر چشم و تیروئید بیماران در هر سه بیمارستان یافت شد ($P < 0.05$). علی رغم تفاوت دز موثر بین دز موثر چشم راست و چپ، بین لب راست و چپ تیروئید اختلاف معناداری مشاهده نشد ($P > 0.05$).

نتیجه گیری: مهمترین عامل پرتوگیری بیماران نحوه انجام آزمون توسط کارشناس مربوط است.

واژه های کلیدی: سی تی اسکن، دزیمتر ترمولومینسانس، دز پرتوی

دریافت مقاله: بهمن ۱۳۹۵
پذیرش مقاله: خرداد ۱۳۹۶

*نویسنده مسئول:
فرشته محمدی؛
دانشکده پرایپزشکی دانشگاه علوم پزشکی
تهران

Email :
mohammadi.fereshteh69@gmail.com

^۱ استاد گروه علوم پرتوی، دانشکده پرایپزشکی، مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

^۲ دانشجوی کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوها، گروه علوم پرتوی، دانشکده پرایپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

^۳ استادیار گروه بیوشیمی - بیوفیزیک، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران



مقدمه

دزیمتر به انرژی، منحنی ساده، محسوسازی پایین است، به عبارت دیگر می تواند اطلاعات را برای مدت زمان زیادی ذخیره کند(۱۳). با توجه به قابلیت های ذکرشده TLD، در مطالعه حاضر از ۱۰۰ TLD ساخت کارخانه PTW و قرائتگر PTW استفاده گردید.

با توجه به حساسیت چشم و تیروئید به پرتو و افزایش روند درخواست های سی تی اسکن، مطالعه‌ی حاضر به ارزیابی دز مؤثر این دو عضو حساس در سی تی اسکن جمجمه و مقایسه‌ی آنها در سه بیمارستان پرداخته است و در نهایت عوامل تاثیر گذار بر روش دز بیماران را بررسی می نماید.

روش بررسی

این مطالعه توصیفی تحلیلی در سه بیمارستان منتخب شهر رشت با ۳ نوع دستگاه سی تی اسکن به نام های GE مدل ۲ اسالیس، GE مدل ۸ اسالیس، Siemens مدل ۱۶ اسالیس، به ترتیب با کد ۱، ۲، ۳ انجام پذیرفت. در طی نمونه گیری هیچ گونه تغییری در شرایط آزمون صورت نپذیرفت و صرفاً دز عدسی چشم و تیروئید بیماران، در سی تی اسکن جمجمه در شرایط رایج و معمول در هر سه بیمارستان توسط TLD بررسی گردید. کالیبراسیون TLD ها در آزمایشگاه دزیمتری استاندارد ثانویه (SSDL) یا Secondary Standard Dosimetry Laboratory به سازمان انرژی اتمی ایران انجام گردید. در این مرحله دو تست کالیبراسیون ضریب تصحیح موردنی(ECC) یا Element Correction Reader (RCF) و ضریب تصحیح خوانشگر (Coefficient Reader) را در روی آنها صورت پذیرفت(روابط ۱ و ۲). به دلیل تفاوت های ساختمانی موجود در تراشه ها و امکان پاسخ متفاوت با وجود منبع تابش یکسان کالیبراسیون RCF بر روی تراشه ها ضروری می باشد(۱۵ و ۱۶). کالیبراسیون ECC نیز به منظور تبدیل بار الکترویکی خوانده شده از لامپ فتومولتی پلایر به واحد دزیمتری انجام شد(۱۷). همچنین به منظور کاهش پرتوهای فرایند Anneling روی تراشه ها انجام پذیرفت(۱۵). در این مرحله تراشه ها به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۲۸۵ درجه قرار داده شد.

$$1 \quad ECC = \langle TLD \rangle / TLDj$$

در رابطه‌ی ۱، $\langle TLD \rangle$ متوسط خوانش در تمامی دزیمترهای ترمولومینسانس و TLD خوانش در یک دزیمتر ترمولومینسانس منفرد می باشد.

در سال های اخیر تصویربرداری با استفاده از سی تی اسکن افزایش یافته است(۱). نوآوری در تکنولوژی ساخت و افزایش کیفیت تصویر در دستگاه سی تی اسکن منجر به افزایش درخواست های بالینی در تصویربرداری با سی تی اسکن شده است. سی تی اسکن بیشترین سهم را در دز تجمعی بیماران، ناشی از تصویربرداری پزشکی به خود اختصاص داده است(۲). این سهم دز بالاتر به دلیل افزایش دز در یک آزمون تنها، نیست بلکه افزایش درخواست سی تی اسکن است(۳). دز رسیده به اندام ها در سی تی اسکن به کارخانه‌ی سازنده و مدل دستگاه و پارامترهای سی تی اسکن بستگی دارد(۴-۶). دز جذبی اندام در بیمارانی که تحت آزمون سی تی اسکن هستند نسبت به همان آزمون در نمای رادیولوژی بیشتر است. برای مثال دز پوست در عکس قفسه سینه ۱۰۰ برابر کمتر از دز پوست در آزمون سی تی اسکن است(۷). در سال های اخیر چندین بررسی به منظور ارزیابی دز انجام شده است. نتایج این بررسی ها حاکی از تفاوت معنادار دز در بخش های مختلف رادیولوژی در آزمون های مشابه است و این تفاوت در دزهای جذبی، لزوم ارزیابی را خاطر نشان می کند(۸). عدسی چشم از جمله اندام های حساس به پرتو می باشد(۸). کمیته بین المللی حفاظت پرتوی (ICRP) یا Commission on Radiological Protection Internatioal توصیه می کند که محدوده ای دز معادل چشم از ۱۵۰ mSv به ۲۰ mSv در سال رسیده است. همچنین آستانه ای دز چشم برای القای کاتاراکت کمتر شده است و برای تابش حاد از ۵ Gy به ۰/۵ Gy رسیده است(۹).

در تصویربرداری با استفاده از پرتوهای اشعه ایکس، پرتوگیری تیروئید به عنوان یک عضو بحرانی حائز اهمیت است و گزارش ها نشان می دهند که حتی مقادیر کم پرتوهای بونیزان، نقش مهمی در ایجاد سرطان ها از جمله سرطان تیروئید دارند(۱۰). شیوع سرطان تیروئید در جهان افزایش یافته و به عنوان یکی از شایعترین سرطان ها در طول ده سال اخیر معرفی شده است. برای نمونه از سال ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۲ میزان این سرطان در امریکا ۲/۴۰ برابر شده است(۱۱). مطالعات نشان می دهد که در برخی از موارد پرتوگیری چشم و تیروئید بیماران فراتر از حد مشخص می باشند(۱۲).

دزیمتر ترمولومینسانس Thermoluminescent Dosimeter (TLD) دارای ویژگی هایی از قبیل حساسیت بالا، وابستگی کم پاسخ

مقدار تابش شده به دزیمترها بر یکی از واحد های دزیمتری است و در

نهایت دز جذبی با استفاده از رابطه $Y = Q \times RCF$


$$\text{دز جذبی} = \text{ECC} \times \text{RCF}$$

۲

$$RCF = Q/L$$

در رابطه $Y = Q \times RCF$ برابر میانگین بارالکترونی خوانده شده توسط

مجموعه ای از دزیمترهاست که زیر تابش معینی از دز قرار گرفته و L

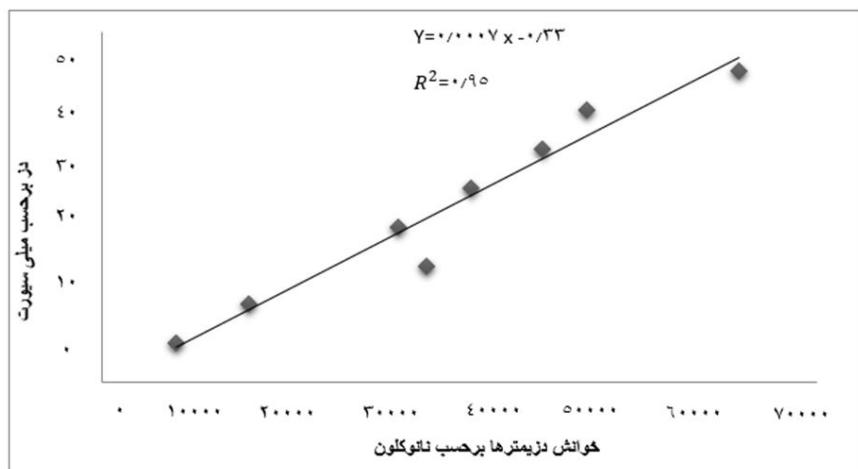


شکل ۱: منعنه دز در مقابل فوانش دزیمترها که با استفاده از کالیبراسیون RCF به دست آمد

انجام گردید. برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون برازنده کولموگروف اسمیرنوف (Kolomogrov-Smirnove Test) استفاده گردید. پس از اطمینان از نرمال بودن (Normal) داده ها، تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) با سطح معنی داری کمتر از ۰/۰۵ برای مقایسه داده ها انجام شد. از ضریب همبستگی پیرسون نیز به منظور بررسی ارتباط معنادار بین پارامترهای مستقل و داده های با سطح معنی داری کمتر از ۰/۰۵ استفاده شد.


پس از کالیبراسیون TLD ها، دزیمتری برای ۵۱ بیمار از ۳ بیمارستان به عمل آمد. در این مرحله ضمن رضایت بیماران از آن ها خواسته شد در طول انجام آزمون چشم های خود را بسته نگاه دارند و بر روی هر پلک آن ها یک عدد دزیمتر و بر روی تیروئید آن ها نیز دو عدد دزیمتر قرار داده شدند. دو عدد دزیمتر هم به منظور سنجش دز زمینه در آزمون در نظر گرفته شد.

تحلیل آماری داده ها با استفاده از SPSS نسخه ۱۶

یافته ها

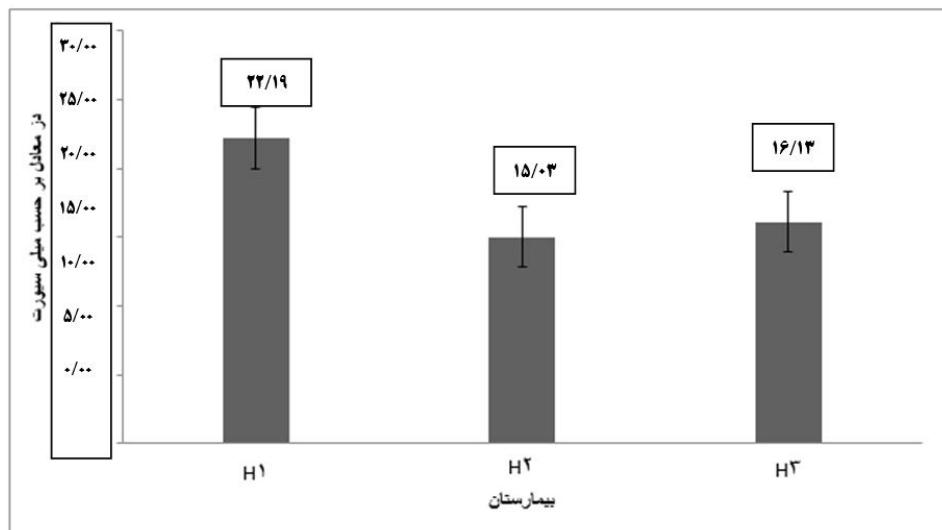

نمودار ۱: مقایسه میانگین دز متعادل چشم بیماران در سه بیمارستان

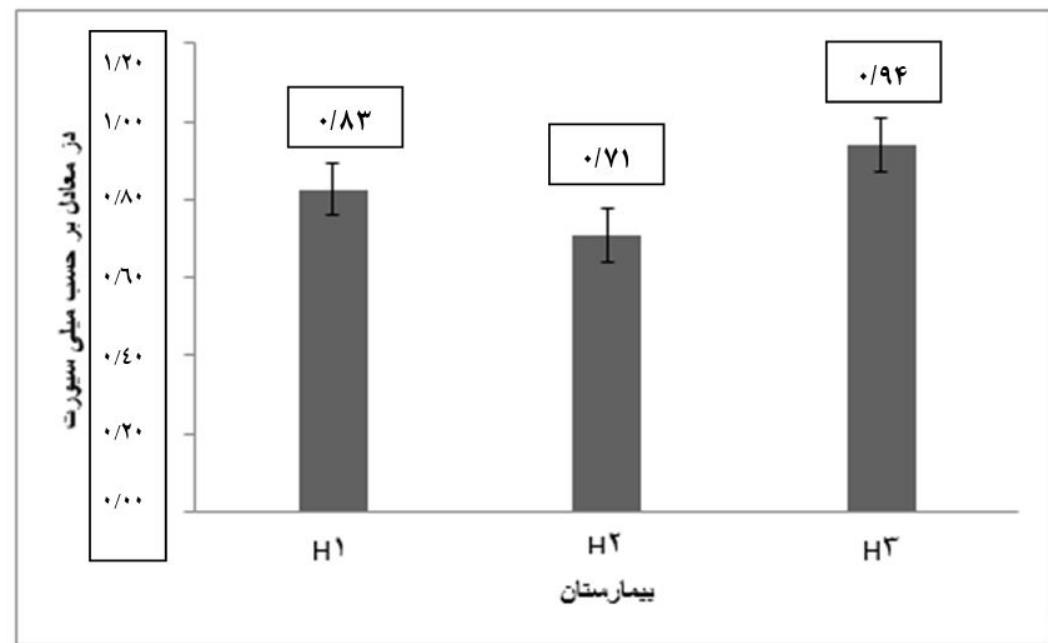

نمودار ۲: مقایسه میانگین دز معادل تیروئید بیماران در سه بیمارستان

متوجه دز معادل چشم و تیروئید بیماران در نمودار های ۱ و ۲ نشان داده شده اند.

جدول ۱: میانگین دز مؤثر چشم و تیروئید بیماران در سه بیمارستان

کد بیمارستان	دز مؤثر تیروئید mSv	دز مؤثر چشم mSv	
۱	۰/۰۳±۰/۰۰۹	۰/۶۶±۰/۰۴	
۲	۰/۰۳±۰/۰۲	۱/۸۰±۱/۱۱	
۳	۰/۰۴±۰/۰۱	۰/۹۴±۰/۹۵	

جدول ۲: میانگین دز مؤثر چشم و تیروئید راست و چپ بیماران در سه بیمارستان

کد بیمارستان	دز مؤثر چشم راست	دز مؤثر چشم چپ	دز مؤثر لب تیروئید راست	دز مؤثر لب تیروئید چپ	
۱	۰/۰۴±۰/۰۰۹	۰/۰۳±۰/۰۰۱	۲/۷۵±۲/۱۵	۲/۵۸±۲/۰۸	
۲	۰/۰۴±۰/۰۵	۰/۰۲±۰/۰۱	۱/۸۲±۱/۲۴	۱/۷۸±۱/۰۶	
۳	۰/۰۴±۰/۰۲	۰/۰۴±۰/۰۱	۲/۰۷±۱/۱۸	۱/۸۰±۱/۱۵	

میانگین دز مؤثر چشم و تیروئید بیماران در جدول های ۱ و ۲ نمایش داده شده اند.

جدول ۳: حداقل و حداکثر دز مؤثر چشم در سه بیمارستان

کد بیمارستان	حداکثر دز مؤثر چشم (mSv)	حداقل دز مؤثر چشم (mSv)	
۱	۰/۳۷	۷/۰۳	
۲	۰/۴۰	۴/۹۴	
۳	۰/۳۰	۳/۰۳	

جدول ۴: مداخل و مداخل دز موثر تیروئید در سه بیمارستان

کد بیمارستان	حداکثر دز موثر تیروئید(mSv)	حداکثر دز موثر تیروئید(mSv)	(mSv)
۱	۰/۰۲	۰/۰۶	
۲	۰/۰۰۷	۰/۱۱	
۳	۰/۰۲	۰/۰۶	

نظر پژوهشکی از چشم ها دور باشد(۲۱). مطالعه‌ی حاضر به بررسی دز موثر چشم و تیروئید بیماران در آزمون سی‌تی اسکن جمجمه در سه بیمارستان پرداخته است. تمام نمونه‌گیری‌ها در شرایط رایج و معمولی موجود در همان بخش انجام شده است. سنجش دز بیماران نیز با استفاده از TLD-۱۰۰ به عمل آمد.

Jibiri & Adewale در سال ۲۰۱۴ دز ورودی عدسی چشم در بالغان را ۱۹/۵۸-۲۵/۰۸ mGy مطرح کردند(۸). مطالعه‌ی حاضر با این نتایج هم خوانی دارد. Seyedatashi و همکاران دز چشم و تیروئید در slice ۱۰ را به ترتیب ۰/۷۷ mGy و ۰/۰۴ mGy دادند(۹). در این مطالعه ۰/۰۵ mGy دز چشم و تیروئید را در slice ۲۵۶ مذکور نمودند؛ همچنین در این مطالعه دز چشم و تیروئید در slice ۱۰ از ۰/۰۸ mGy گزارش کردند؛ همچنین در این مطالعه دز چشم و تیروئید در سی‌تی اسکن اسپیرال جمجمه در سی‌تی اسکن ۰/۰۵ mGy داشتند(۱۰). در مطالعه‌ی حاضر بیشترین دز چشم بیماران را سی‌تی اسکن GE مدل ۲ اسلایس به خود اختصاص داد. در بررسی مهدوی و همکاران دز جذبی چشم راست و چپ به ترتیب ۱۱/۲۰ mGy و ۱۳/۳۰ mGy داشتند(۱۱). در مطالعه‌ی حاضر بیشترین دز چشم را سی‌تی اسکن Philips به ترتیب ۰/۰۵ mGy داشتند(۱۲). یافته‌های مطالعه‌ی حاضر با یافته‌های فوق مطابقت ندارند. در مطالعه‌ی حاضر دز موثر سمت چپ بیماران نسبت به سمت راست در هر سه بیمارستان بالاتر بود. نتایج این مطالعه با نتایج مطالعات حدادی و همکاران تاحدودی هم خوانی دارد. در مطالعه‌ی حدادی و همکاران، دز چشم راست و چپ به ترتیب ۷/۱۴ mGy و ۷/۱۴ mGy داشتند(۱۳). موارد فوق بیانگر اهمیت مکان تیوب اشعه ایکس در حین تابش است. اهمیت مسئله‌ی فوق در مطالعه‌ی Schmidt و همکاران بررسی شده است(۱۴). در مطالعه‌ی حاضر، مشاهده شد که مکان تیوب در تصویر اولیه (Scout) در سمت چپ بیمار قرار دارد. می‌توان ابراز داشت به علت قرارگیری دزیمتر سمت چپ بیمار در فاصله‌ی کمتر نسبت به تیوب اشعه ایکس و بر اساس

حداکثر و حداکثر دز موثر چشم و تیروئید در جدول ۳ و ۴ نشان داده شده است.

به منظور مقایسه‌ی دز موثر چشم و تیروئید بیماران از آزمون تجزیه و تحلیل واریانس با سطح اطمینان ۹۵٪ استفاده شد. نتایج نشان داد که بین دز موثر چشم و تیروئید بیماران اختلاف معناداری وجود دارد($P<0/05$). علی‌رغم وجود تفاوت در دز موثر چشم‌های راست و چپ بیماران، اختلاف معناداری میان آنها یافت نگردید($P>0/05$). همچنین بین دز موثر لبه‌ای راست و چپ تیروئید نیز اختلاف معناداری یافت نشد($P>0/05$).

به منظور بررسی میزان تاثیر متغیرها بر دز دریافتی بیماران از آزمون ضریب هم بستگی پرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که تنها در بیمارستان ۱، میلی‌آمپر و تعداد مقاطع بر روی دز موثر چشم بیماران و تعداد مقاطع بر دز موثر تیروئید بیماران تاثیر دارد($P<0/05$). ارتباط معناداری بین پارامترهای مستقل از جمله زاویه‌ی گانتری، تعداد مقاطع، میلی‌آمپر بر روی دز بیماران در سایر بیمارستان‌ها یافت نشد($P>0/05$). این در حالی است که تنها پارامتر متغیر در بیمارستان ۳، زاویه‌ی گانتری بود و سایر شرایط ثابت بود.

بحث

با گذشت زمان استفاده از سی‌تی اسکن افزایش یافته است که منجر به افزایش دز پرتوی دریافتی بیماران و افزایش خطر ابتلا به سرطان شده است(۱۵). ارزیابی و اندازه‌گیری دز در طول آزمون‌های سی‌تی اسکن به منظور رعایت اصل ALARA یا AS Low AS Responsibility Achievable می‌باشد(۱۶). چشم‌ها و تیروئید اندام‌های سطحی هستند بنابراین سنجش دز سطحی در آن‌ها می‌تواند تخمین خوبی را از دز عدسی چشم و غده تیروئید نشان دهد(۱۷). همچنین در سی‌تی اسکن جمجمه، ممکن است چشم که جزو اندام‌های حساس بدن است در معرض تابش غیرضروری پرتو قرار گیرد، حتی اگر محدوده‌ی مورد


و میانگین تعداد مقاطع بوده است(۲۲). البته ذکر این نکته ضروری است که مرکز قلب تهران دارای بیشترین مقدار mAs و کمترین مقدار میانگین تعداد مقاطع بوده است. یافته های مطالعه‌ی حاضر با نتایج مطالعه‌ی فوق مطابقت دارد. در مطالعه‌ی حاضر نوع بیمارستان و شرایط حاکم در هر بیمارستان در پرتوگیری بیماران موثر است. در بیمارستان با کد ۳ میانگین زمان تابش و mA و تعداد مقاطع نسبت به سایر بیمارستان‌های منتخب کمتر بوده است، بنابراین دز موثر رسیده به چشم و تیروئید در این بیمارستان کمتر از سایر بیمارستان‌های منتخب یافت شد.

قانون عکس مجذور فاصله این قست دز دریافتی بالاتری نسبت به سمت راست داشته است. اگرچه تایید این موضوع نیاز به تحقیقات بیشتری دارد.

خلیل پور و همکاران به بررسی "محاسبه دز اعضای ناشی از معاینه‌ی سی تی اسکن معمولی سر با استفاده از نرم افزار ImPACT در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران" پرداختند. در این مطالعه بیشترین میزان دز دریافتی مغز در بیمارستان امام خمینی و کمترین میزان دز دریافتی در بیمارستان امیراعلم گزارش شد. همچنین بیان شد که بیمارستان امام خمینی دارای بیشترین میزان mAs و میانگین تعداد مقاطع بوده و بیمارستان امیراعلم کمترین مقدار mAs



الف: تصویر توبوگرام از جمجمه بیمار ۱

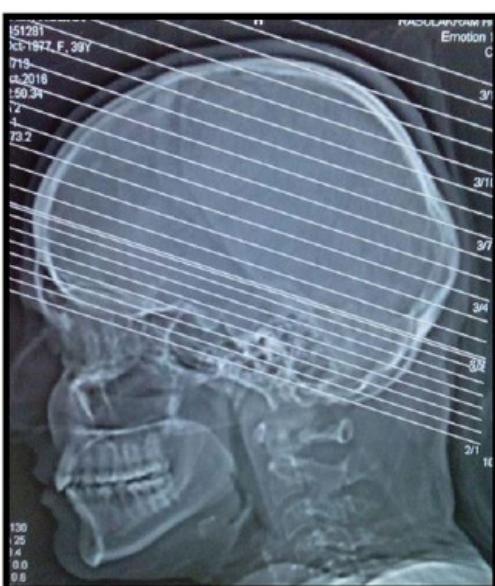

ب: تصویر توبوگرام از جمجمه بیمار ۲



داشته است. از آنجایی که این نمونه گیری در سه بیمارستان صورت گرفته است، لذا هماهنگی بیمارستان‌ها و نمونه گیری از بیماران یکی از مشکلات این پژوهش بوده، همچنین قرائت TLD‌ها در دانشکده فیزیک پژوهشکی تهران صورت پذیرفته است، بنابراین انتقال TLD‌ها در بین دو استان مشکل دیگر این پژوهش بوده است.

نتیجه گیری

مطالعه حاضر نشان داد که در شرایط بالینی، مهمترین عامل پرتو گیری بیماران در سی تی اسکن روش انجام آزمون است که به پرتونگار بستگی دارد. به منظور حفظ اصل ALARA و کاهش دز بیماران افزایش آگاهی پرتونگاران از طریق آموزش مداوم توصیه می‌شود.

تشکر و قدردانی

این تحقیق قسمتی از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته رادیوپیولوژی و حفاظت پرتوی با شماره ۲۸۰/ر/۳۶ دانشگاه علوم پژوهشکی تهران است که با حمایت این دانشگاه و همکاری دانشگاه علوم پژوهشکی گیلان به انجام رسیده است.

در تصاویر الف و ب شرایط تابش دهی هر دو بیمار یکسان بود. دز موثر چشم و تیروئید بیمار شماره یک به ترتیب $1/88 \text{ mSv}$ و $0/04 \text{ mSv}$ و بیمار شماره دو به ترتیب $0/61 \text{ mSv}$ و $0/03 \text{ mSv}$ گزارش شد. همان طور که در تصویر الف دیده می‌شود چشم در معرض مستقیم اشعه قرار دارد و TLD تحت تابش مستقیم پرتو قرار گرفته است اما در تصویر ب اینگونه نیست. در مطالعه‌ی Nikupaava و همکاران گزارش شد که با زاویه دادن به گانتزی، تا جایی که ممکن است می‌توانیم دز چشم را کاهش دهیم بدین طریق که چشم‌ها در سی تی اسکن جمجمه در معرض تابش نباشند(۲۳). نتایج مطالعه‌ی حاضر با این یافته مطابقت ندارد زیرا علاوه بر زاویه، عوامل دیگری همچون نحوه‌ی چینش خطوط مقاطع اهمیت دارد. در تصویر الف و ب تمامی شرایط از جمله زاویه یکی بود(هر دو ۱۷ درجه).

در مطالعه‌ی Koller و همکاران به بررسی "تفاوت دز پرتوی در دستگاه سی تی اسکن مولتی اسلایس در بیمارستان‌های مختلف با مدل یکسان" پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد که کاهش معنی دار دز پرتویی از طریق همکاری نزدیک میان فیزیک پژوهشکان، رادیولوژیست‌ها و پرتوکاران امکان پذیر است(۲۴)؛ که با مطالعه حاضر هم خوانی دارد. همان طور که در تصویر الف و ب مشاهده شد، انتخاب خطوط مقاطع توسط پرتوکار نقش مهمی در دز بیماران

منابع

- Boice JD Jr. Radiation epidemiology and recent paediatric computed tomography studies. Annals of the ICRP 2015; 44(1): 236-48.
- Tsalafoutas IA & Metallidis SI. A method for calculating the dose length product from ct dicom images. The British Journal of Radiology 2011; 84(999): 236-43.
- Schmidt B, Saltybaeva N, Kolditz D & Kalender WA. Assessment of patient dose from ct localizer radiographs. Med Phy 2013; 40(8): 84301.
- Matsunaga Y, Kawaguchi A, Kobayashi K, Kobayashi M, Asada Y, Minami K, et al. Effective radiation doses of ct examinations in Japan: A nationwide questionnaire-based study. The British Journal of Radiology 2016; 89(1058): 20150671.
- Pages J, Buls N & Osteaux M. Ct doses in children: A multicentre study. The British Journal of Radiology 2003; 76(911): 803-11.
- Mori S, Endo M, Nishizawa K, Murase K, Fujiwara H & Tanada S. Comparison of patient doses in 256-slice ct and 16-slice ct scanners. The British Journal of Radiology 2006; 79(937): 56-61.
- Huda W, Ogden KM, Lavallee RL, Roskopf ML & Scalzetti EM. Kerma ratios in pediatric ct dosimetry. Pediatric Radiology 2012; 42(5): 527-35.
- Jibiri N & Adewale A. Estimation of radiation dose to the lens of eyes of patients undergoing cranial computed tomography in a teaching hospital in Osun state, Nigeria. International Journal of Radiation Research 2014; 12(1): 53-60.



9. Sandblom V. Evaluation of eye lens doses received by medical staff working in interventional radiology at Sahlgrenska university hospital. Available at: https://www.gu.se/digitalAssets/1360/1360091_viktor-sandblom-rapport.pdf. 2012.
10. Saeb M & Fatehi D. Thyroid exposure in brain ct-scan and skull x-ray, using different levels of ma and kvp with and without thyriod shield. Journal of Sharekord University of Medical Sciences 2011; 13(2): 19-25[Article in Persian].
11. Su YP, Niu HW, Chen JB, Fu YH, Xiao GB & Sun QF. Radiation dose in the thyroid and the thyroid cancer risk attributable to ct scans for pediatric patients in one general hospital of China. International Journal of Environmental Research and Public Health 2014; 11(3): 2793-803.
12. Haddadi G, Mehdizadeh S, Haddadi M & Meshkibaf M. Evaluation of absorbed dose of critical organ rando phantom under head, abdomen and pelvis spiral ct scan by thermo luminescent dosimetry (tld). Journal of Fasa University of Medical Sciences 2011; 1(3): 131-5[Article in Persian].
13. Kortov V. Materials for thermoluminescent dosimetry: Current status and future trends. Radiation Measurements 2007; 42(4): 576-81.
14. Mianji F & Baradaran S. Quantitative evaluation of lif: Mg, ti (tld-100) long-term sensitivity stability. Available at: http://www.jbpe.org/Journal_OJS/JBPE/index.php/jbpe/article/view/418.2016.
15. Banaee N & Nedaie H. Evaluating the effect of energy on calibration of thermo-luminescent dosimeters 7-lif: Mg, cu, p (gr-207A). Int J Radiat Res 2013; 11(1): 51-4.
16. Mahdavi M, Hosseinezhad M & Vahabi Moghaddam M. Determination of radiosensitive organs in head ct for the head area. Iranian Journal of Science and Technology 2015; 39(1-3): 441-4.
17. Hasabelrasoul HA. Estimation of uncertainty in tld calibration [Thesis]. Sudan: Sudan Academy of Science; 2013.
18. Tan J, Tan KL, Lee J, Wan CM, Leong JL & Chan LL. Comparison of eye lens dose on neuroimaging protocols between 16- and 64-section multidetector CT: Achieving the lowest possible dose. American Journal of Neuroradiology 2009; 30(2): 373-7.
19. Seyedatashi SF, Athari M, Bitarafan-Rajabi A, Hasanzadeh H, Rafati M, Pouraliakbar HR, et al. Dosimetric evaluation of multislice ct using anthropomorphichead phantom. Frontiers in Biomedical Technologies 2015; 2(1): 31-5.
20. Stathopoulos I, Ploussi A, Syrgiamiotis V, Makri T, Hatzigorgi C, Carinou E, et al. In vivo dosimetry for head ct examinations in paediatric patients. Physica Medica 2016; 32(1): 205-6.
21. Ciarmatori A, Nocetti L, Mistretta G, Zambelli G & Costi T. Reducing absorbed dose to eye lenses in head ct examinations: The effect of bismuth shielding. Australasian Physical & Engineering Sciences in Medicine 2016; 39(2): 583-9.
22. Khalilpour M, Norouzzadeh SH & Dadras M. Assessment of brain absorbed x-ray dose during ct-scan using impact software in Tehran univeristy hospitals. School of Medicine of Tehran University Medical Sciences Journal 2009; 67(4): 257[Article in Persian].
23. Nikupaavo U, Kaasalainen T, Reijonen V, Ahonen SM & Kortesniemi M. Lens dose in routine head ct: Comparison of different optimization methods with anthropomorphic phantoms. American Journal of Roentgenology 2015; 204(1): 117-23.
24. Koller CJ, Eatough JP & Bettridge A. Variations in radiation dose between the same model of multislice ct scanner at different hospitals. The British Journal of Radiology 2003; 76(911): 798-802.



Investigating and Comparing Safety Level of Thyroid and Eye Effective Radiation Dose in Cranial Multi Slice CT Scans

Changizi Vahid¹ (Ph.D.) - Mohammadi Fereshteh² (B.S.) - Ebrahiminia Ali³ (Ph.D.)

1 Professor, Radiation Sciences Department, School of Allied Medical Sciences, Health Information Management Research Center, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran

2 Master of Sciences Student in Radiation Biology and Radiation Protection, Radiation Sciences Department, School of Allied Medical Sciences, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Biochemistry & Biophysics Department, School of Medicine, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran

Abstract

Received: Jan 2017

Accepted: May 2017

* Corresponding Author:
Mohammadi F;
Email:
mohammadi.fereshteh69@gmail.com

Background and Aim: CT scan as a medical imaging modality delivers high radiation dose to the patients. Since eye and thyroid are two radiosensitive organs in this study, those effective doses were evaluated in brain CT scan. Using TLD as dosimeter.

Materials and Methods: This cross-sectional study was carried out in three selective hospitals in Rasht in September and October in year 2016. TLD was used as personal dosimeter. To measure the effective dose, TLDs were put on the patient's eyes and thyroid and the mean effective dose was evaluated in brain CT scan. Results were analytical using SPSS software and Anova ($P<0.05$).

Results: The mean effective doses of eyes and thyroid in three hospitals with codes of H1, H2 and H3 were obtained as 2.66 ± 2.04 mSv and 0.03 ± 0.009 mSv, 1.80 ± 1.11 mSv and 0.03 ± 0.02 mSv, 1.94 ± 0.95 mSv, 0.04 ± 0.01 mSv, respectively. We found significant differences between effective doses of the eyes and thyroid in the three hospitals ($p<0.05$). Despite the difference in effective doses between right and left sides of eyes and thyroid, we didn't find any other significant differences.

Conclusion: The most important factor affecting patient radiation dose is the way CT scan examination is performed.

Keywords: CT Scan, Thermoluminescent Dosimeter, Radiation Dose